


NOTICE D'UTILISATION

Ancillaire SAXXO



Généralités

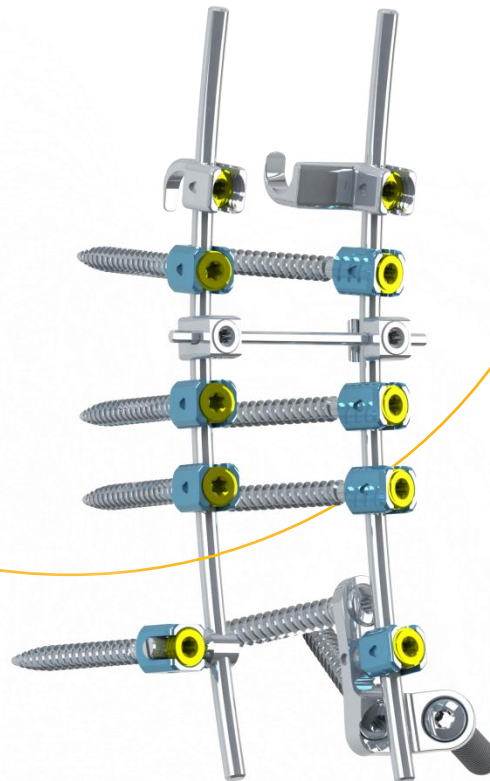



OSD recommande que l'ensemble du personnel soignant en contact avec du matériel ancillaire prenne connaissance de la présente notice d'utilisation.

L'utilisation du matériel ancillaire nécessite des connaissances de l'anatomie, de la biomécanique et de la chirurgie du rachis, le matériel ancillaire ne peut être utilisé que par un chirurgien qualifié qui pratique cette chirurgie en prenant en compte les données actuellement disponibles de la science et de l'art chirurgical.

Description

L'ancillaire est constitué de l'instrumentation (matériel ancillaire), de rangements et d'un container.

Il est nécessaire de prendre connaissance de la technique opératoire et en cas de doute, contacter le représentant de la Société OSD pour obtenir toute information nécessaire à l'utilisation du matériel ancillaire et des implants associés.

En outre, certains instruments ne sont pas fournis avec le jeu standard, ils peuvent être mis à disposition sur demande.

En aucun cas, un ancillaire ou un composant d'ancillaire ne doit être implanté.

Le matériel ancillaire peut être fabriqué en acier inoxydable, en alliage de titane, en polymère et en silicone.

Les matières sont biocompatibles, en outre toute modification apportée aux dispositifs peut remettre en cause tant leurs performances techniques que biologiques.

Indications

Le matériel ancillaire d'OSD a été spécialement développé pour faciliter la pose ou l'explantation des implants SAXXO et ne peut être utilisé exclusivement qu'à cet usage.

Il est de la responsabilité de l'établissement de santé de procéder à la pré-désinfection, au nettoyage et à la stérilisation de l'ancillaire après son utilisation selon des méthodes validées. Les recommandations ci-jointes ne se substituent pas aux règles sanitaires en vigueur : normes, bonnes pratiques, guides, recommandations nationales, textes ministériels, etc.

Contre-indications

Allergie connue à l'un des constituants du matériel ancillaire (notamment au nickel).

Les contre-indications sont principalement associées au dispositif SAXXO (notice SAXXO IMPLANTS : Rev_20170615_SAX_IFU).

OSD se dégage de toute responsabilité dans le cas du non-respect des indications et contre-indications de l'ancillaire et des implants SAXXO.

Inspection et vérification de la fonctionnalité des ancillaires SAXXO

Par mesure de prévention contre des blessures éventuelles des patients et des utilisateurs, un contrôle doit toujours être exécuté à la réception de l'instrument et avant chaque utilisation. Toute détérioration peut entraîner des risques de dysfonctionnement.

A réception, les jeux d'instruments doivent faire l'objet d'un examen minutieux.

La référence de matériel ancillaire est inscrite sur le dispositif.

Par ailleurs, il est important de vérifier la disponibilité de l'ensemble des dispositifs, le cas échéant des différentes tailles (exemple : tarauds) constituant le jeu d'ancillaire, à partir des instructions et besoins formulés par le chirurgien.

Une liste du matériel livré est jointe à l'envoi de l'ancillaire.

Dès lors qu'un instrument est associé à un autre au cours de la procédure chirurgicale, il est nécessaire de vérifier que les dispositifs s'assemblent correctement. Vérifier l'action des pièces mobiles (exemple, pince) pour s'assurer de leur bon fonctionnement, les précisions et modalités d'utilisation sont disponibles sur le site internet d'OSD : <http://www.osdevelopment.fr>

Inspectez attentivement chaque dispositif afin de s'assurer que toute contamination visible a bien été éliminée ou que tout dommage et/ou usure excessive soient identifiés.

En cas de contamination visible, il est impératif de renouveler la procédure de nettoyage et de désinfection.

Tout dispositif endommagé doit être isolé et retourné à OSD.

Effets indésirables

Allergie à l'un des constituants du matériel ancillaire.

Effets indésirables des implants SAXXO (notice SAXXO IMPLANTS : Rev_20170615_SAX_IFU)

- **Avertissements et précautions**

Des précautions doivent être prises lors de la manipulation de dispositifs notamment dans le cas de dispositifs pointus ou tranchants.

Dans le cas d'un instrument livré seul. A réception il est nécessaire d'ôter le sachet plastique avant nettoyage et stérilisation.

Les instruments articulés (pinces) doivent être ouverts, afin d'améliorer l'efficacité du lavage.

Afin de garantir la fonctionnalité et la sécurité du matériel, les consignes ci-jointes doivent être respectées :

- Ouverture du conditionnement doit être réalisée à proximité du champ opératoire;
- Les DM doivent être manipulés avec précaution;
- L'utilisation de brosses, de tampons à récurer en métal ou tout outil susceptible d'altérer le matériel ancillaire durant les procédures de nettoyage manuelles est à proscrire.
- Privilégier l'usage de brosses en nylon à poils doux.
- L'usage de produits chimiques à base de chlore, acides, de solvants organiques ou ammoniacaux est à proscrire.
- L'usage de produits chimiques à base de soude est à proscrire pour les containers.
- L'usage d'acide pour la neutralisation des résidus alcalins à la fin du cycle de lavage automatique sur les plateaux en aluminium, et les instruments ayant des éléments en polymère est à proscrire.
- De manière générale il est nécessaire de faire attention aux différents éléments dans le cas où une pièce venait à manquer : perdue ou cassée, nous vous invitons à contacter OSD.
- Ne pas laisser sécher les instruments après utilisation, les dispositifs souillés qui ont séché sont plus difficiles à nettoyer.
- Ne pas utiliser d'huile minérale ou de lubrifiants à base de silicone car ils enrobent les micro-organismes, empêchent le contact direct de la surface avec la vapeur et sont difficiles à éliminer.
- Ne pas apporter de modification aux instruments.
- Le sérum physiologique et les agents de nettoyage/désinfection contenant de l'aldéhyde, du mercure, du chlore actif, du chlorure, du brome, du bromure, de l'iode ou de l'iodure sont corrosifs et ne doivent pas être utilisés.
- Des agents de nettoyage et enzymatiques à pH neutre sont recommandés.

Remarque : Les actes d'orthopédie ne sont pas considérés comme à risques vis-à-vis des ATNC. Une inactivation totale à l'aide de soude molaire (1N) ou d'hypochlorite de sodium à la concentration de 2% de chlore actif ne doit être réservée qu'aux instruments ayant été utilisés sur un patient suspect ou atteint d'EST avant l'acte invasif.

- **Précaution / retraitement**

Le cas échéant, il est impératif de retirer les excédents de liquides organiques et de tissus des instruments avec une lingette non pelucheuse jetable.

Il est recommandé de ne pas laisser sécher la solution saline, le sang, des fragments osseux, tissulaires ou d'autres débris organiques sur les instruments avant de les nettoyer.

Placez les instruments dans un bac d'eau distillée ou dans un plateau couvert avec des serviettes humides.

Un équipement de protection personnel doit être porté lors de la manipulation des dispositifs contaminés.

- **Pré-Désinfection**

La pré-désinfection a pour but de diminuer la population de micro-organismes et de faciliter le nettoyage ultérieur. Elle a également pour objectif de protéger le personnel lors de la manipulation des instruments et d'éviter la contamination de l'environnement. Tout dispositif réutilisable doit subir une pré-désinfection immédiate ou être traité sans délai en laveur désinfecteur.

ATTENTION : Les containers et plateaux de rangement ne doivent pas être mis en contact prolongé avec ce type de décontaminant ; nettoyer la zone souillée et rincer immédiatement.

- **ATNC**

Il est nécessaire de respecter les dispositions dans :

- L'instruction française DGS/RI3/2001/449 du 1^{er} décembre 2011 relative à l'actualisation des recommandations visant à réduire les risques de transmissions d'agents transmissibles non conventionnels lors des actes invasifs
- La circulaire française DGS/SD5C/DHOS/2005/435 du 23 septembre 2005 relative aux recommandations pour le traitement des dispositifs médicaux utilisés chez les sujets ayant reçu des produits sanguins labiles (PSL) provenant de donneurs rétrospectivement atteints de variant de la maladie de Creutzfeld-Jakob (vMCJ).

Instructions de nettoyage, désinfection et de stérilisation :

- **Nettoyage / désinfection :**

Le nettoyage et la désinfection selon la procédure indiquée sont obligatoires avant stérilisation des matériels ancillaires réutilisables.

Cette étape a pour objectif d'enlever toutes les salissures et résidus sur les ancillaires suite à l'intervention, afin de réduire le nombre de micro-organismes viables sur les ancillaires avant stérilisation.

Les méthodes de nettoyage et désinfection couramment utilisées sont : le nettoyage manuel et le nettoyage automatique.

Le choix du moyen mis en œuvre est sous la responsabilité de l'établissement.

Afin de garantir l'efficacité du nettoyage et de la désinfection, veuillez respecter la notice du produit de nettoyage.

Durant cette étape, une attention particulière doit être portée aux zones sensibles et/ou ayant un accès difficile afin que le produit et l'action de nettoyage soit optimaux.

Dans un premier temps, il est indispensable de retirer les excès de liquides et de tissus organiques avec un tampon non pelucheux jetable. Puis placer les dispositifs dans un plateau d'eau distillée ou couvrir avec un linge humide.

Procédure de nettoyage/désinfection automatique :

Placer les instruments dans le panier d'un laveur/désinfecteur adapté, conformément aux instructions du fabricant et traiter via le cycle recommandé pour les ancillaires OSD et décrit ci-dessous :

- **Pré-nettoyage**

- Désassemblage des instruments, le cas échéant.
- Immersion pendant 5 min au moins dans de l'eau froide du robinet.
- Brosser les surfaces avec une brosse en nylon jusqu'à disparition des souillures visibles.
- Rinçage pendant 20 secondes sous jet à pression (entre 3 et 4 bar ou 43,5 et 58 psi), en insistant sur les canules.

- **Laveur/désinfecteur**

Utiliser un laveur/désinfecteur type MIELE G7735 CD ainsi que son programme Vario TD, selon ces étapes :

- 2 minutes de pré-nettoyage dans l'eau froide
- Vidanger.
- 5 minutes de nettoyage dans l'eau déminéralisée à 55°C et 0,5% de détergent alcalin doux, (exemple : NeodisherMediClean - Dr.Weigert).
- Vidanger.
- 3 minutes de rinçage et de neutralisation avec de l'eau déminéralisée.
- Vidanger.
- 2 minutes de rinçage final avec de l'eau déminéralisée
- Vidanger.
- Séchage, chiffon sec, non pelucheux, propre voire stérile.

Vérifier que les instruments et les lumières n'ont plus aucune souillure.

Si besoin, répéter le cycle de nettoyage.

Après nettoyage/désinfection, les instruments désassemblés doivent être réassemblés et inspectés visuellement.



- **Inspection avant stérilisation :**

Inspecter attentivement chaque dispositif pour s'assurer de l'élimination de toute contamination visible. Si besoin, répéter le processus de nettoyage et de désinfection.

Par ailleurs, vérifier l'absence de déformation des instruments.

- **Stérilisation :**

L'obtention et le maintien de l'état stérile des ancillaires sont sous la responsabilité des établissements de santé. La stérilisation à la vapeur/chaleur humide est la méthode recommandée.

Toutefois, le service commercial d'OSD est à votre écoute pour toute information complémentaire.

Les dispositions à prendre pour la protection des arêtes pointues ou potentiellement blessantes des instruments doivent également être prises en considération par l'établissement de santé.

OSD recommande de respecter les recommandations du fabricant du stérilisateur, qui doivent toujours être suivies. Lors de la stérilisation de plusieurs jeux d'instruments dans un cycle de stérilisation, il est important de s'assurer de ne pas dépasser la charge maximum indiquée par le fabricant.

Les jeux d'instruments doivent être correctement préparés et emballés dans des plateaux et/ou boîtes pour permettre à la vapeur de pénétrer et d'entrer en contact direct avec toutes les surfaces.

Se reporter aux informations ci-dessous pour les paramètres de stérilisation des cycles validés par OSD afin d'offrir un niveau d'assurance de stérilité (NAS) de 10^{-6} .

Les méthodes de stérilisation à l'oxyde d'éthylène ou au plasma ne doivent pas être utilisées.

Paramètres de stérilisation à la vapeur validés :

Type de cycle : vide préalable - Température 134° C (273.2°F)

Durée d'exposition : 18 minutes - Temps de séchage : 20 minutes.

REPARATIONS

Tout dispositif endommagé ne doit plus être utilisé et doit être retourné pour réparation à OSD.

Afin de protéger les personnes en charge de la réparation, les instruments ne peuvent être renvoyés pour réparation que s'ils ont subi les procédures de Décontamination / Nettoyage / Stérilisation. Si les ancillaires sont souillées ou si des modifications sont constatées sur les produits à réparer, OSD se réserve le droit de réparer ces DM à vos frais ou de refuser complètement la réparation.

OSD décline toute responsabilité en cas de modification ou de réparation effectuée sur les dispositifs par l'établissement.

ELIMINATION

Le cas échéant, le dispositif peut être éliminé selon les bonnes pratiques d'élimination des déchets d'activité de soins à risques infectieux. Il n'y a pas de risque spécial ou inhabituel lié à l'élimination de ce dispositif.

RETOUR EXPEDITION

L'établissement de santé doit désinfecter, nettoyer, stériliser et convenablement emballer les prêts d'ancillaires (boîte complète ou instrument isolé) avant de les retourner chez OSD.

Par ailleurs, lorsque l'établissement de santé n'a pas la propriété du DM, il en accepte la facturation et prend toutes les dispositions nécessaires pour son paiement dans les cas suivants :

- Lorsque le DM est destiné à être utilisé dans des circonstances où il y a suspicion de contact avec des ATNC (patient ou acte chirurgical à risque) ;

- Lorsqu'une destruction du DM est imposée dans le cadre de l'observation de règles sanitaires ainsi qu'en cas de non-respect des consignes d'OSD mentionnées dans la présente notice en matière de stockage, décontamination, nettoyage et stérilisation et induisant une détérioration du matériel.

GARANTIE

La société OSD garantit que ses produits livrés sont conformes aux spécifications qui leur sont associées.

En outre, cette garantie ne s'applique pas dans le cas d'une mauvaise utilisation, ou d'une mauvaise manipulation du dispositif. OSD décline toute responsabilité quant à l'utilisation d'accessoires additionnels utilisés lors de l'implantation du dispositif SAXXO.








Tout instrument défectueux doit être retourné à OSD pour être remplacé voire détruit.



Cette notice doit être accessible et gardée à proximité de l'instrumentation, OSD ne pourra être tenu pour responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation et/ou manipulation du dispositif et dans le cas où des réparations et/ou des modifications seraient apportées à l'instrument par une personne non-autorisée.

La société OSD ne garantit pas le résultat clinique, sachant que des risques résiduels peuvent compromettre la réussite de la chirurgie.

Pour assurer une utilisation optimale des dispositifs, il convient de respecter les symboles suivants :


Symboles utilisés						
						
Consulter le manuel d'utilisation	Fabricant	Non stérile	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	N° catalogue	Conserver à l'abri de la lumière du soleil	Craint l'humidité

**ORTHOPAEDIC & SPINE
DEVELOPMENT**
 Chemin de Fontanille - BP 11211

 84911 AVIGNON Cedex 9 - FRANCE
 Tél : +33 (0)4.32.74.01.10
 Fax : +33 (0)4.90.80.02.39
info@osdevelopment.fr
www.osdevelopment.fr

INSTRUCTIONS FOR USE

SAXXO Instruments

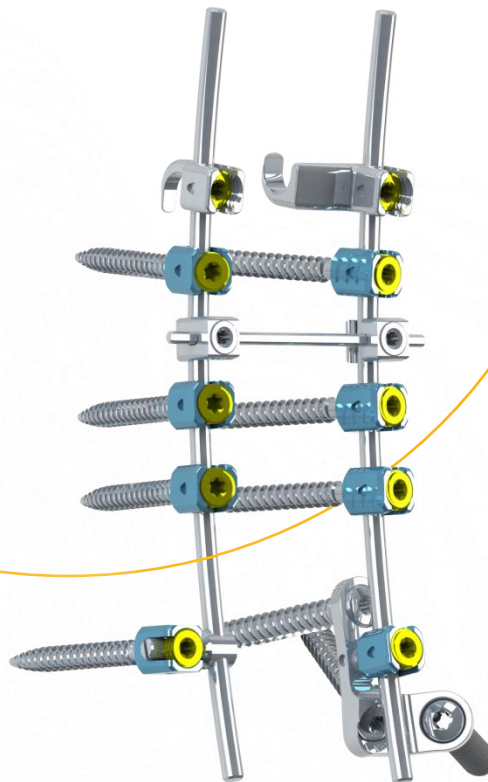

Generalities

OSD recommends that all medical staff in contact with instrument take knowledge of these instructions for use.

The using of the material requires anatomy knowledge, biomechanical and spine surgery knowledge, material can not be used by a qualified surgeon who practices this surgery taking account science and surgical art data available at this moment.

Description

Instrument is composed of the instrumentation (instrument material), storage and a container.

It is necessary to take knowledge of the surgical technique and in case of any doubt; contact OSD Company agent's to obtain all information necessary to the using of the instrument and associated implants.

Besides, some instruments are not delivered with standard set, they can be providing if request.

In no way, an instrument or an instrument component can not be implanted.

Instrument material can be made in stainless steel, in titanium alloy, in polymer and in silicon.

The materials are biocompatible, besides all modification provided to devices may call into question their technics and biologics.

Indications

OSD material instrument has been developed especially to facilitate the implantation or the ablation of SAXXO implants and must be used exclusively for this use.

The Health institute is responsible to proceed to the pre-disinfection, cleaning and the sterilization of the instruments after its using according to the validated methods. The advices attached not are a substitute for current sanitary rules: norms, good practice, handbook, national advices, ministerial texts, etc.

Contraindications

Allergy known to one of the material component (in particular to nickel).

The contraindications are associated mostly for SAXXO device (instructions for use SAXXO IMPLANTS: Rev_20170615_SAX_IFU).

OSD accepts no responsibility in case of indications and contraindications non-respect concerning SAXXO instrument and implants.

Functionality inspection and verification of SAXXO instruments

As a precautionary measure against possible patients and users injuries, a control must be made every time at the reception of the instrument and before each using. All breakdowns can cause serious risks.

At the reception, instruments set must be controlled with precision.

The reference of the instrument is written on the device.

Furthermore, it is important to verify the availability of all devices, if need be different sizes (for example: tap) constituting set instrument, from instructions and expressed needs by the surgeon.

A list of delivered material is attached to the instrument shipment.

When an instrument is associated to an other during the surgical process, it is necessary to verify that the device is correctly assembled. Verify the action of moving part (for example, pliers) to insure good function, precisions and using modalities are available on OSD website: <http://www.osdevelopment.fr>

Inspect carefully each device to insure that all visible contamination has been eliminated or all damage and/or excessive wear are identified.

In case of visible contamination, it is obligatory to renew cleaning and disinfection process.

All device damages must be isolated and returned at OSD.



Side effects

Allergy to one of the material component.

Side effects SAXXO implants (instruction for use SAXXO IMPLANTS: Rev_20170615_SAX_IFU)

- **Warnings and precautions**

Precautions must be taken during the handling of devices in particular in case of devices are sharpened or edged.

In case of an instrument is delivered alone. At reception it is necessary to remove plastic bag before cleaning and sterilization.

The articulated instruments (pliers) must be opened, to improve the washing efficacy.

In order to ensure the functionality and the security of the material, the instructions attached must be respected:

- Opening of the packaging must be realized near surgical site;
- MD must be handled with care ;
- The using of brushes, metal stamp scrub or all tools which may alter the instrument during manual cleaning process is forbidden.
- Favour the using of soft nylon brushes.
- The using of chemical products with chlorine, acids, and organics solvent or ammoniacal is forbidden.
- The using product with soda is forbidden for the container.
- The using of acid for the neutralization of alcalin residue at the end of automatic washing cycle on aluminum trays, and instruments comportsing polymer elements is forbidden.
- In general it is necessary to pay attention to the different elements in case where a part was lacking, lost or broken:, we invite you to contact OSD.
- Not air dry the instruments after using, the soiled devices which have been dried are harder to clean.
- Not use mineral oil or lubricant with silicon because they covered micro-organisms, prevent the direct contact of the superficies with the vapor and are hard to eliminate.
- Not bring modification to the instruments.
- The saline solution and cleaning agents/disinfection containing aldehyde, mercury, active chlorine, chloride, bromine, bromide, iodine or iodide are corrosive and must be not used.
- Cleaning agents and enzymatic with neutral pH are recommended.

Note: Orthopedic acts are not considered like risk at the ATNC. A total inactivation with molar soda (1N) or sodium hypochlorite with a concentration of 2% of active chlorine not is reserved to the instruments used previously on suspect or suffering EST before invasive act.

- **Precaution / retreatment**

If need be, it is obligatory to remove the surplus of organics liquids and tissues of the instruments with a lint-free disposable wipe.

It is recommended to not air dry the saline solution, blood, osseous fragments, tissue or other organic debris on the instruments before to clean them.

Place the instruments in distilled water bath or in a tray covers with damp towels.

Equipment for personal protection must be weared during the handling of the contaminated devices.

- **Pre-Disinfection**

The pre-disinfection has to aim to reduce the micro-organism population and to facilitate the ulterior cleaning. It has also to ail to protect the staff during the handling of the instruments and avoid the contamination of the environment. All re-usable device shall be an immediately pre-disinfection or be treated without delay in disinfect scrubbed.

WARNING: Containers and storage trays not must be in prolonged contact with this type of decontaminant ; clean the soiled zone and rinse immediately.

- **ATNC**

It is necessary to respect the dispositions in:

- French instruction DGS/R13/2001/449 of 1st December 2011 pertaining to the updating advices aiming to reduce disease risks of non-conventional transmissible agents during invasive act
- French circular DGS/SD5C/DHOS/2005/435 of 23th September 2005 pertaining to the advices for medical devices treatment used on subjects who have received labile blood products (PSL) coming from donors retrospectively affected on cases of variant Creutzfeld-Jakob (vMCJ) disease

Cleaning, disinfection and sterilization instructions:

- **Cleaning / disinfection :**

Cleaning and disinfection are obligatory before sterilization of re-usable material according to the indicated process.

This step has to aim to remove all soiling and residue on the instruments cause to the surgery, in order to reduce the number of viable micro-organism on the instruments before sterilization.

Cleaning and disinfection method common used are: manual cleaning and automatic cleaning.

The choice of implementation is under responsibility of the institute.

In order to ensure the cleaning and disinfection efficacy, please respect the instruction for use of the cleaning product.

During this step, a special attention should be given to sensible zone and/or which has a difficult access so that the product and the cleaning action are optimal.

In first time, it is important to remove the liquids excess and organics tissues with a lint-free disposable wipe. And place the devices on a distilled water tray or cover with a damp towel.

Cleaning/automatic disinfection process:

Place the instruments in the washer/disinfector adapted basket, according to the instructions of the manufacturer and treat via the recommended cycle for OSD instruments and describes below:

- **Pre-cleaning**

- Disassembly of the instruments, if necessary.
- Immersion during 5 min at least on cold tap water.
- Brush the superficies with a nylon brush until the disappearance of visible residue.
- Rinsing during 20 seconds under pressure jet (between 3 and 4 bar or 43,5 and 58 psi), insisting on cannula.

- **Washer/disinfector**

Use a washer/disinfector type MIELE G7735 CD as well as its program Vario TD, according to these steps:

- 2 minutes of pre-cleaning on cold water
- Flush.
- 5 minutes of cleaning on demineralized water at 55°C and 0,5% of soft alcalin detergent, (for example : NeodisherMediClean - Dr.Weigert).
- Flush.
- 3 minutes of rinsing and neutralization with demineralized water.
- Flush.
- 2 minutes of final rinsing with demineralized water
- Flush.
- Drying, dry cloth, lint free, clean and sterile.

Verify that the instruments and the lumens have not residue.

If necessary, repeat the cleaning cycle.

After cleaning/disinfection, the disassembled instruments must be reassembled and inspected visually.

- **Inspection before sterilization :**

Inspect with attention each device to ensure the elimination of all visible contamination. If necessary, repeat the cleaning and disinfection process.

Furthermore, verify the absence of the instruments deformation.

- **Sterilization :**

The obtention and maintain of the sterile state of instruments are under the responsibility of the health institute. The sterilization with vapor/moist heat is the recommended method.

Furthermore, OSD commercial service is here to help you for all complementary information.

The dispositions to take for the protection of sharped crest or potentially injuring instruments must be taken in consideration by the health institute.

OSD recommends respecting the recommendations of the manufacturer concerning the sterilizer, which must be every time followed. During the sterilization several instruments sets on the sterilization cycle, it is important to ensure do not exceed the maximal load indicated by the manufacturer.

Instruments sets must be prepared and packaged correctly in trays and/or boxes to permit to the vapor to penetrate and enter in direct contact with all the superficies.

Refer to the below information for the sterilization parameters of validated cycles by OSD in order to give an insurance level of sterility (NAS) of 10^{-6} .

Sterilization methods to ethylene oxide or to plasma not must be used.

Sterilization parameters to the validated vapor:

Type of cycle: air removal - Temperature 134° C (273.2°F)

Exposition time: 18 minutes – Drying time : 20 minutes.

REPARATIONS

All device damaged must be not used and must be returned for reparation at OSD.

In order to protect the personal responsible of the reparation, instruments can not be returned for reparation only if the Decontamination/Cleaning/Sterilization processes are respected. If the instruments are soiled or if modifications are noted on the products to repair, OSD reserves the right to repair these DM to your cost or to refuse the entire reparation.

OSD is not responsible in case of modification or reparation effectuated on the devices by the institute.

ELIMINATION

If need be, the device can be eliminated according to the good practice of infectious elimination waste. There is no special risk or unusual associated to the device elimination.

SHIPMENT RETURN

Health institute must disinfect, clean, sterilize and package correctly the instruments (complete box or isolated instrument) before to return them at OSD.

Furthermore, when the health institute has not the MD property, it accepts invoicing and takes all the necessaries for the payment in the following cases:

- When the MD is destined to be used in circumstances where there is suspicion of ATNC contact (patient or surgical act with risk) ;

- When the destruction of the DM is imposed as part of the observation of sanitary rules and also if OSD instructions are not respected, instructions mentioned on this instructions for use concerning the storage, decontamination, cleaning and sterilization and inducing a material deterioration.

GUARANTEE

OSD Company guarantees that its products delivered are compliant to the specifications which are associated.








Furthermore, this guarantee can not be applied in case of bad using, or bad handling of SAXXO device. OSD is not responsible concerning the additional using accessories used during the implantation of SAXXO device.

All defective instruments must be returned at OSD to be replaced or destroyed.

This instructions for use must be accessible and kept close to the instrumentation, OSD should not be responsible of damages resulting a bad using and/or device handling and in case where repair and/or modification should be given to the instrument by a non-authorized person.

OSD Company not guarantees the clinical result, knowing that residual risks can compromise the success of the surgery.

To ensure an optimal using of devices, it should be respected the following symbols:

Symbols used						
						
Consult instructions for use	Manufacture	Not sterile	Do not use if package is damaged	Catalog Number	Keep away from sunlight	Keep dry

ORTHOPAEDIC & SPINE
DEVELOPMENT
Chemin de Fontanille - BP 11211

84911 AVIGNON Cedex 9 - FRANCE

Tél : +33 (0)4.32.74.01.10


Fax : +33 (0)4.90.80.02.39

info@osdevelopment.fr

www.osdevelopment.fr

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Instrumentos SAXXO

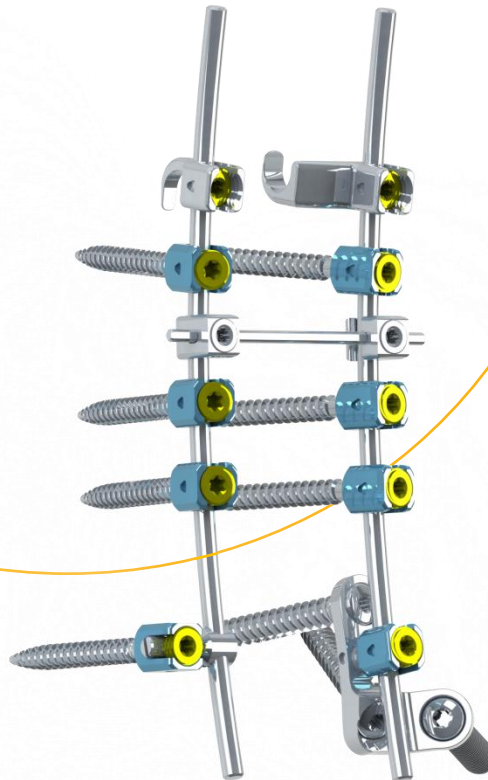



Generalidades

OSD recomienda a todo el personal sanitario en contacto con los instrumentos de tener conocimiento de este manual de instrucciones.

El uso de los instrumentos necesita conocimientos de la anatomía, de la biomecánica y de la cirugía del raquis, los instrumentos se utilizan solamente por un cirujano capacitado quien practica esta cirugía tomando en cuenta los datos actualmente disponibles de la ciencia y del arte quirúrgica.

Descripción

El instrumento se constituye de la instrumentación (material instrumental), alacenas y de un contenedor.

Es necesario de tener conocimiento de la técnica quirúrgica y en caso de duda, contactar el representante de la empresa OSD para obtener toda información necesaria al uso del instrumental y de los implantes asociados.

Además, algunos instrumentos no son entregados con el kit estándar, pueden estar a su disposición si preguntado.

En ninguno caso, un instrumento o un componente de instrumento no deben estar colocados.

Los instrumentos pueden ser fabricados en acero inoxidable, en aleación de titanio, en polímero y en silicona.

Las materias son biocompatibles, además toda modificación traída a los dispositivos puede poner en causa sus desempeños técnicos y biológicos.

Indicaciones

Los instrumentos OSD fueron especialmente desarrollados para facilitar la colocación o el ablación de los implantes SAXXO y no pueden ser utilizados exclusivamente a este uso.

El establecimiento de salud es responsable de proceder a la pre-desinfección, a la limpieza y a la esterilización del instrumento después su uso según los métodos validados. Las recomendaciones adjuntadas no se substituyen a las reglas sanitarias en vigor: normas, buenas prácticas, guías, recomendaciones nacionales, textos ministeriales, etc.

Contra-indicaciones

Alergia conocida a uno de los constituyentes del material (sobretudo al níquel).

Las contra-indicaciones son principalmente asociadas al dispositivo SAXXO (manual de instrucciones SAXXO IMPLANTES: Rev_20170615_SAX_IFU).

OSD no es responsable en caso de no-respeto de las indicaciones y contra-indicaciones del instrumento y de los implantes SAXXO.

Inspección y verificación de la funcionalidad de los instrumentos SAXXO

Para tomar medidas de prevención contra las heridas posibles de los pacientes y los utilizadores, un control debe siempre efectuarse a la recepción del instrumento y antes cada uso. Todo deterioro puede causar riesgos de disfuncionamiento.

A recepción, los kit de instrumentación deben pasar un examen minucioso.

La referencia del instrumento esta escrita en el dispositivo.

Además, es importante de verificar la disponibilidad de todos los dispositivos, si no es el caso los diferentes tamaños (por ejemplo : terrajas tornillo) constituyendo el kit de instrumentación, a parte de las instrucciones y necesidades preguntadas por el cirujano.

Una lista del material esta adjuntada al envío de los instrumentos.

Cuando un instrumento esta asociado a un otro durante el proceso quirúrgico, es necesario de verificar que los dispositivos se congregaran correctamente. Verificar el acción de las piezas móviles (por ejemplo, pinza) para asegurar el buen funcionamiento, las precisiones y modalidades de uso son disponibles en el sitio internet de OSD: <http://www.osdevelopment.fr>

Controlar con atención cada dispositivo con el fin de asegurar que toda contaminación visible fue eliminada o que todo daño y/o desgaste excesivo sean identificados.

En caso de contaminación visible, es imperativo de repetir el proceso de limpieza y de desinfección.

Todo dispositivo dañado debe estar retirado y vuelto a OSD.

Efectos adversos

Alergia a uno de los constituyentes del material.

Efectos adversos de los implantes SAXXO (manual de instrucciones SAXXO IMPLANTES: Rev_20170615_SAX_IFU)

- **Advertencias y precauciones**

Las precauciones deben estar tomadas durante la manipulación de los dispositivos sobretodo en caso de dispositivos agudos o cortantes.

En caso que un instrumento entregado solo. A recepción es necesario de retirar la bolsita plástica antes de limpiar y esterilizar.

Los instrumentos articulados (pinzas) deben estar abiertas, con el fin de mejorar la eficacia de la limpieza.

Con el fin de asegurar la funcionalidad y la seguridad del material, las instrucciones adjuntadas deben estar respetadas:

- Apertura del envase debe estar realizada cerca del campo operatorio;
- Los DM deben estar manipulados con precaución;
- El uso de cepillos, de tapones a fregar en metal o toda herramienta susceptible de modificar los instrumentos durante los procesos de limpieza manuales es prohibido.
- Favorecer el uso de cepillos en nilón con pelos suaves.
- El uso de productos químicos con cloro, acido, solventes orgánicos o amoniacales es prohibido.
- El uso de productos químicos con soda es prohibido para los contenedores.
- El uso de acido para la neutralización de los residuos alcalinos al final del ciclo de limpieza automática en los platos en aluminio, y los instrumentos conteniendo elementos en polímero es prohibido.
- De manera general es necesario de hacer cuidado a los diferentes elementos en el caso donde una pieza venia a faltar: pérdida o rota, le invitamos a contactar OSD.
- No dejar a secar los instrumentos después el uso, los dispositivos sucios que fueron secados son más difíciles a limpiar.
- No usar aceite mineral o lubricantes con silicona porque cubren los micro-organismos, impiden el contacto directo de la superficie con el vapor y son difíciles a eliminar.
- No dar modificación a los instrumentos.
- La solución salina y los agentes de limpieza/desinfección conteniendo aldehído, mercurio, cloro activo, cloruro, bromo, yodo o yoduró son corrosivos y no deben estar utilizados.
- Los agentes de limpieza y enzima con pH neutral son recomendados.

Nota: Los actos ortopédicos no son considerados como riesgos frente a los ATNC. Una inactivación total de la ayuda de soda molar (1N) o de hipoclorito de sodio con una concentración de 2% de cloro activo no debe estar reservada a los instrumentos utilizando en un paciente sospechoso o afectado de EST antes el acto invasivo.

- **Precaución / retratamiento**

El otro caso, es imperativo de retirar los excesos de líquidos orgánicos y de tejidos de los instrumentos con un pañuelo no afelpado desechable.

Se recomienda de no dejar a secar la solución salina, la sangre, los fragmentos óseos, tejidos o otros residuos orgánicos en los instrumentos antes de limpiarlos.

Poner los instrumentos en una bandeja de agua destilada o en un plato tapado con toallas húmedas.

Un equipo de protección personal debe estar vestido durante la manipulación de los dispositivos contaminados.

- **Pre-Desinfección**

La pre-desinfección tiene por objetivo de disminuir la población de los micro-organismos y de facilitar la limpieza ulteriormente. Tiene también por objetivo de proteger el personal sanitario durante la manipulación de los instrumentos y de evitar la contaminación del ambiente. Todo dispositivo reutilizable debe soportar una pre-desinfección inmediatamente o estar tratado sin tiempo en un lavador desinfectado.

ATENCIÓN: Los contenedores y platos de almacén no deben estar en contacto con este tipo de descontaminante; limpiar la zona sucia y aclarar inmediatamente.

- **ATNC**

Es necesario de respetar las disposiciones en:

- La instrucción francesa DGS/RI3/2001/449 del 1^{er} de Diciembre de 2011 relativa a la actualización de las recomendaciones concerniendo la reducción de los riesgos de transmisiones de agentes transmisibles no convencionales durante los actos invasivos
- La circular francesa DGS/SD5C/DHOS/2005/435 del 23 de Septiembre de 2005 relativa a las recomendaciones para el tratamiento de los dispositivos médicos utilizados en las personas que recibieron productos sanguíneos lábiles (PSL) proviniendo de los donantes sufriendo de la enfermedad de Creutzfeld-Jakob (vMCJ).

Instrucciones de limpieza, desinfección et de esterilización:

- **Limpieza / desinfección :**

La limpieza y la desinfección según el proceso indicado son obligatorios antes la esterilización de los instrumentos reutilizables.

Esta etapa tiene por objetivo de quitar todos los residuos en los instrumentos después de la cirugía, con el fin de reducir el número de micro-organismos viables en los instrumentos antes la esterilización.

Los métodos de limpieza y de desinfección utilizados son: la limpieza manual y la limpieza automática.

La selección del medio implementado es en la responsabilidad del establecimiento.

Con el fin de asegurar la eficacia de limpieza y de desinfección, gracias de respetar el manual de instrucciones del producto de limpieza.

Durante esta etapa, una atención especial a las zonas sensibles y/o teniendo un acceso difícil con el fin que el producto y el acción de limpieza sean óptimos.

Para empezar, es importante de retirar los excesos de líquidos y de tejidos orgánicos con un tapan no afelpado y desechable. Después colocar los dispositivos en un plato de agua destilada o cobrar con un pañuelo húmedo.

Proceso de limpieza/desinfección automática:

Colocar los instrumentos en una cesta de un lavador/desinfectado adaptado, según las instrucciones del fabricante y tratar vía el ciclo recomendado para los instrumentos OSD y describe mas abajo:

- **Pre-limpieza**

- Desmontaje de los instrumentos, si es necesario.
- Inmersión durante 5 min al mínimo en agua fría del grifo.
- cepillar las superficies con un cepillo en nilón hasta que todos los residuos no sean visibles.
- aclarado durante 20 segundos en jet de presión (entre 3 y 4 bar o 43,5 y 58 psi), insistiendo en las cánulas.

- **Lavador/desinfectado**

Usar un lavador/desinfectado de tipo MIELE G7735 CD así que su modo Vario TD, según estas etapas:

- 2 minutos de pre-limpieza en agua fría
- Aclarar.
- 5 minutos de limpieza en agua desmineralizada con 55°C y 0,5% de detergente alcalino suave, (por ejemplo: NeodisherMediClean - Dr.Weigert).
- Aclarar.
- 3 minutos de aclarado y de neutralización con agua desmineralizada.
- Aclarar.
- 2 minutos de aclarado final con agua desmineralizada
- Aclarar.
- Secado, pañuelo seco, no afelpado, limpio y estéril.

Verificar que los instrumentos y las luces no tienen residuos.

Si es necesario, repetir el ciclo de limpieza.

Después la limpieza/desinfección, los instrumentos desmontados deben estar reseñados y controlados visualmente.

- **Inspección antes esterilización :**

Controlar con atención cada dispositivo para asegurarse de la eliminación de toda contaminación visible. Si es necesario, repetir el proceso de limpieza y de desinfección.
Además, verificar la ausencia de deformación de los instrumentos.

- **Esterilización :**

La obtención y el mantenimiento del estado estéril de los instrumentos son en la responsabilidad de los establecimientos de salud. La esterilización con vapor/calor húmeda es el método recomendado.
Sin embargo, el servicio comercial de OSD esta a su disposición para toda información complementaria.
Las disposiciones a tomar para la protección de las crestas agudas o potencialmente lesionando de los instrumentos deben también estar tomadas en consideración por el establecimiento de salud

OSD recomienda de respetar las recomendaciones del fabricante del esterilizador, que deben siempre estar seguidas. Durante la esterilización de varios kit de instrumentación en un ciclo de esterilización, es importante de asegurarse de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.
Los kit de instrumentación deben estar correctamente preparados y envasados en los platos y/o cajas para permitir al vapor de entrar en contacto directo con todas las superficies.

Referirse a las informaciones mas abajo para los parámetros de esterilización de los ciclos validados por OSD con el fin de ofrecer un nivel de aseguración de esterilidad (NAS) de 10^{-6} .
Los métodos de esterilización con oxido de etileno o al plasma no deben estar utilizados.

Parámetros de esterilización con vapor validados:

Tiempo de ciclo: vacío previo - Temperatura 134° C (273.2°F)

Tiempo de exposición: 18 minutos – Tiempo de secado: 20 minutos.

REPARACIONES

Todo dispositivo dañado no debe estar utilizado y debe estar vuelto para reparación a OSD.

Con el fin de proteger las personas en carga de la reparación, los instrumentos no pueden estar vueltos para reparación que si subieron los procesos de Descontaminación/Limpieza/Esterilización. Si los instrumentos son sucios o si modificaciones son notadas en los productos a reparar, OSD se reserva el derecho de reparar estos DM a sus costos o de rechazar completamente la reparación.

OSD rechaza toda responsabilidad en caso de modificación o de reparación efectuada en los instrumentos por el establecimiento.

ELIMINACIÓN

Si es necesario, el dispositivo puede estar eliminado según las buenas prácticas de eliminación de los desechos de actividad de cuidados con riesgos infecciosos. No hay riesgo especial o inhabitual asociado a la eliminación de este dispositivo.

VUELTA DE ENVIO

El establecimiento de salud debe desinfectar, limpiar, esterilizar y adecuadamente envasar los instrumentos (caja completa o instrumento retirado) antes de volverlos a OSD.

Además, cuando el establecimiento de salud no tiene la propiedad del DM, el acepta la facturación y toma todas las disposiciones necesarias para su pago en los casos siguientes:

- cuando el DM se destina a estar utilizado en las circunstancias donde hay sospecha de contacto con los ATNC (paciente o acto quirúrgico con riesgo) ;
- cuando una destrucción del DM esta obligatoria en el cuadro de la observación de las reglas sanitarias así que en caso de n-respeto de las instrucciones de OSD mencionadas en este manual de instrucciones concerniendo el almacenen, descontaminación, limpieza y esterilización y concluyendo a una deterioración del material.

GARANTIA

La empresa OSD garantiza que sus productos entregados son conformes a las especificaciones que son asociadas.








Además, esta garantía no puede aplicarse en el caso de un malo uso, o de una mala manipulación del dispositivo. OSD no es responsable concerniendo el uso de accesorios añadidos utilizados durante la colocación del dispositivo SAXXO.

Todo instrumento defectuoso debe estar vuelto a OSD para estar reemplazado o destruido.

Este manual de instrucciones debe estar accesible y cerca de la instrumentación, OSD no será responsable de los daños resultando de un mal uso y/o manipulación del dispositivo y en el caso donde las reparaciones y/o modificaciones estarían traídas al instrumento por una persona no autorizada.

La empresa OSD no garantiza el resultado clínico, sabiendo que los riesgos residuales pueden comprometer el éxito de la cirugía.


Para asegurar un uso óptimo de los dispositivos, es necesario de respetar los símbolos siguientes:

Símbolos utilizados						
						
Consultar el manual de instrucciones	Fabricante	No esteril	No utilizar si el embalaje está dañado	Número de catálogo	Conservar al abrigo de la luz del sol	Sensible al humedad

**ORTHOPAEDIC & SPINE
DEVELOPMENT**
 Chemin de Fontanille - BP 11211

 84911 AVIGNON Cedex 9 - FRANCE
 Tél : +33 (0)4.32.74.01.10
 Fax : +33 (0)4.90.80.02.39
info@osdevelopment.fr
www.osdevelopment.fr

Zubehör SAXXO

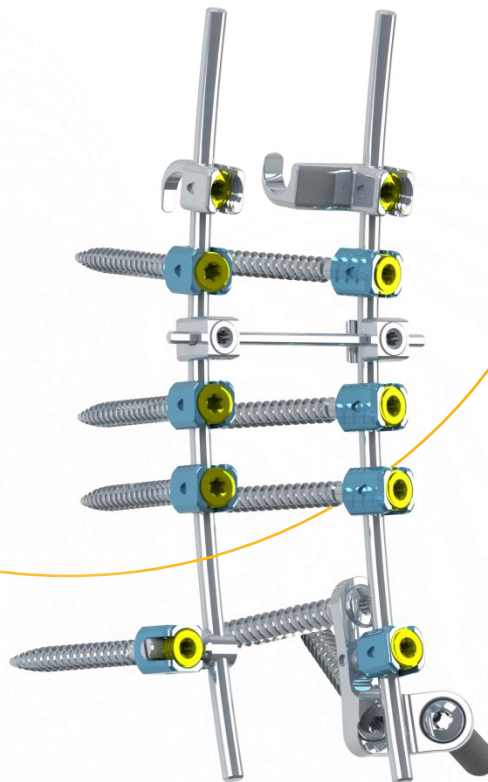

Allgemeines

OSD empfiehlt, dass das gesamte Pflegepersonal, das mit Hilfsmaterialien in Kontakt kommt, die vorliegende Bedienungsanleitung zur Kenntnis nimmt.

Die Verwendung von Hilfsmaterial erfordert Kenntnisse von Anatomie, Biomechanik und der Wirbelsäulenchirurgie. Das Hilfsmaterial darf nur von einem qualifizierten Chirurgen verwendet werden, der diese Operation/en ausführt und dabei die derzeitig verfügbaren Daten aus der Wissenschaft und Chirurgie beachtet.

Beschreibung

Bei dem Zubehör handelt es sich um Instrumente (Hilfsmaterial), Ablagen und einen Container.

Es ist notwendig, die Operationstechnik zu kennen und sich im Zweifelsfall an den Vertreter des Unternehmens OSD zu wenden, um alle Informationen zu erhalten, die für die Verwendung des Hilfsmaterials und der dazugehörigen Implantate notwendig sind.

Im Übrigen werden bestimmte Instrumente nicht mit dem Standardset geliefert, können aber auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Es darf keinesfalls Zubehör oder ein Bestandteil des Zubehörs implantiert werden.

Das Hilfsmaterial ist möglicherweise aus rostfreiem Stahl, Titanlegierung, Polymer oder Silikon hergestellt.

Die Materialien sind biokompatibel. Außerdem kann jede Änderung an den Medizinprodukten die technischen sowie die biologischen Leistungen in Frage stellen.

Indikationen

Das Hilfsmaterial von OSD wird speziell entwickelt, um das Einsetzen oder die Explantation der Implantate SAXXO zu erleichtern und darf ausschließlich für diesen Zweck verwendet werden.

Es liegt in der Verantwortung der klinischen Institution die Vordesinfektion, die Reinigung und die Sterilisation des Instrumentes nach seinem Gebrauch gemäß den validierten Methoden durchzuführen. Die beigefügten Empfehlungen ersetzen nicht die geltenden Hygienevorschriften: Normen, gute Praxis, Leitfäden, nationale Empfehlungen, ministerielle Texte u.a.

Kontraindikationen

Bekannte Allergie gegenüber einem der Bestandteile des Materials des Hilfsmaterials (insbesondere Nickel):

Die Kontraindikationen stehen hauptsächlich mit dem Medizinprodukt SAXXO in Zusammenhang (Bedienungsanleitung SAXXO IMPLANTATE: Rev_20170615_SAX_IFU).

OSD lehnt jede Verantwortung im Fall der Nichtbeachtung von Indikationen und Kontraindikationen für Zubehör und die Implantate SAXXO ab.

Inspektion und Überprüfung der Funktionsweise des Zubehörs SAXXO

Als Prävention gegen eventuelle Verletzungen der Patienten oder der Anwender ist das Instrument bei Empfang und vor jedem Gebrauch stets zu kontrollieren. Jede Beschädigung kann das Risiko einer Fehlfunktion zur Folge haben.

Bei Entgegennahme muss der Instrumentensatz sorgfältig untersucht werden.

Die Teilenummer des Hilfsmaterials ist immer auf dem Medizinprodukt vermerkt.

Im Übrigen ist es wichtig zu prüfen, ob nach Anweisungen und den durch vom Chirurgen formulierten Bedarf alle Medizinprodukte verfügbar sind, soweit verschiedene Größen (z. B. Gewindeschneidern) in dem Zubehörset vorhanden sind.

Der Sendung des Hilfsmaterials ist eine Liste des gelieferten Materials beigelegt.

Sobald ein Instrument mit einem anderen im Verlauf der Operation in Verbindung gebracht wird, muss geprüft werden, ob die Produkte korrekt zusammenpassen. Überprüfen Sie die Funktionsweise der mobilen Teile (z. B. Klemme), um Ihre einwandfreie Funktionsweise sicherzustellen, die Präzisionen und Verwendungsmodalitäten finden sich auf der Website von OSD: <http://www.osdevelopment.fr>

Inspizieren Sie jedes Medizinprodukt sorgfältig, um sicherzustellen, dass jede sichtbare Kontamination entfernt wurde oder jeder Schaden und/oder übermäßige Abnutzung identifiziert wurde.

Bei sichtbarer Kontamination ist es unbedingt erforderlich, dass der Reinigungs- und Desinfektionsvorgang wiederholt wird.

Jedes beschädigte Medizinprodukt ist auszusortieren und an OSD zurückzusenden.

Unerwünschte Wirkungen

Allergie gegenüber einem der Bestandteile des Materials des Hilfsproduktes.

Unerwünschte Wirkungen der Implantate SAXXO (Bedienungsanleitung SAXXO IMPLANTATE: Rev_20170615_SAX_IFU)

- **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Vorsichtsmaßnahmen sollten bei der Behandlung von Medizinprodukten ergriffen werden, insbesondere im Fall von spitzen und schneidenden Produkten.

Bei Lieferung eines Einzelinstrumentes. Bei Entgegennahme muss der Plastikbeutel vor der Reinigung und Sterilisation entfernt werden.

Instrumente mit Gelenken (Klemmen) müssen geöffnet werden, um die Wirkung der Spülung zu verbessern.

Um die Funktionsweise und Sicherheit des Materials zu garantieren müssen die beigegefügte Anweisungen beachtet werden:

- Die Verpackung muss in der Nähe des Operationsfeldes geöffnet werden;
- Die Medizinprodukte müssen immer mit Vorsicht behandelt werden;
- Die Verwendung von Bürsten, Scheuerschwämmchen aus Metall oder jedes Werkzeug, wodurch das Hilfsmaterial während der manuellen Reinigungsvorgänge verändert werden kann, ist untersagt.
- Der Gebrauch von weichen Nylonbürsten ist vorzuziehen.
- Die Verwendung von chlor-, säurehaltigen chemischen Produkten mit organischen und ammoniakhaltigen Lösungsmitteln ist untersagt.
- Die Verwendung von natronhaltigen chemischen Erzeugnissen ist bei Containern zu vermeiden.
- Die Verwendung von Säure zur Neutralisierung von alkalischen Resten am Ende des automatischen Waschzyklus bei Aluminium-Tabletts und Instrumenten mit Elementen aus Polymer ist untersagt.
- Im Allgemeinen ist es notwendig, auf die unterschiedlichen Elemente zu achten, und sich im Fall eines fehlenden Teils - sei es verloren oder defekt - an OSD zu wenden.
- Lassen Sie die Instrumente nach Gebrauch nicht trocknen. Verunreinigte Medizinprodukte, die abgetrocknet sind, lassen sich schwerer reinigen.
- Verwenden Sie kein mineralisches Öl oder silikonhaltige Schmiermittel, denn sie hüllen Mikroorganismen ein und verhindern somit den direkten Kontakt der Oberfläche mit dem Dampf und sind daher schwer zu entfernen.
- Verändern Sie die Instrumente nicht.
- Physiologisches Serum und Reinigungs-/Desinfektionsmittel, die Aldehyd, Quecksilber, aktives Chlor, Chlorid, Brom, Bromid, Iod und Iodid enthalten, dürfen nicht verwendet werden.
- Reinigungsmittel und enzymatische Substanzen mit einem neutralen pH-Wert werden empfohlen.

Anmerkung: Eingriffe in der Orthopädie werden nicht als durch unkonventionelle übertragbare Krankheitserreger gefährdet angesehen. Eine vollständige Inaktivierung mittels einmolarer Natronlauge (1n) oder Natriumhypochlorit in einer Konzentration von 2 % aktivem Chlor muss Instrumenten vorbehalten bleiben, die beim Patienten verwendet werden, bei dem der Verdacht auf TSE besteht oder der vor dem invasiven Eingriff davon betroffen war.

- **Vorsicht/Wiederaufbereitung**

Falls erforderlich, ist es zwingend notwendig, überschüssige Körperflüssigkeiten und Gewebe von Instrumenten mit einem fusselfreien Einwegreinigungstuch zu entfernen.

Es wird empfohlen, vor der Reinigung die Kochsalzlösung, Blut, Knochenfragmente, Gewebe oder andere organische Ablagerungen auf den Instrumenten nicht antrocknen zu lassen.

Legen Sie die Instrumente in Behälter mit destilliertem Wasser oder auf ein mit nassen Handtüchern abgedecktes Tablett.

Bei Handhabung von kontaminierten Produkten muss eine persönliche Schutzausrüstung getragen werden.

- **Vordesinfektion**

Die Vordesinfektion zielt darauf ab, die Population von Mikroorganismen zu reduzieren und die anschließende Reinigung zu erleichtern. Ziel ist es auch, das Personal bei der Handhabung der Instrumente zu schützen und eine Kontamination des Umfeldes zu vermeiden. Jedes wiederverwendbare Medizinprodukt muss unmittelbar einer Vordesinfektion unterzogen werden oder unverzüglich Reinigungs-/Desinfektionsautomaten behandelt werden.

ACHTUNG: Container und Ablagetabletts dürfen nicht länger mit dieser Art von Dekontamination in Berührung kommen; reinigen und spülen Sie unverzüglich den verunreinigten Bereich.

- **Unkonventionell übertragbare Erreger**

Die folgenden Bestimmungen müssen beachtet werden:

- Die französische Vorschrift DGS/RI3/2001/449 vom 1. Dezember 2011 bezüglich der Aktualisierung der Empfehlungen, die darauf abzielen, die Übertragungsrisiken durch unkonventionelle übertragbare Krankheitserreger während invasiver Eingriffe zu reduzieren.
- Der französische Runderlass DGS/SD5C/DHOS/2005/435 vom 23. September 2005 hinsichtlich der Empfehlungen für die Behandlung von beim Patienten verwendeten Medizinprodukten, die labile Blutprodukte (LBP) retrospektiv mit einer Variante der Creutzfeld-Jakob-Krankheit (vMCJ) erhalten.

Anweisungen für die Reinigung, Desinfektion und Sterilisation:

- **Reinigung/Desinfektion:**

Die Reinigung und Desinfektion gemäß den angegebenen Verfahren sind vor der Sterilisation der wiederverwendbaren Hilfsmaterialien erforderlich.

Dieser Schritt zielt darauf ab, allen Schmutz und Rückstände auf dem Zubehör nach dem Eingriff zu entfernen, um die Anzahl der lebenden Mikroorganismen auf dem Zubehör vor der Sterilisation zu verringern.

Verfahren zur Reinigung und Desinfektion, die häufig verwendet werden, sind folgende: manuelle Reinigung und automatische Reinigung.

Die Wahl des eingesetzten Mittels liegt in der Verantwortung der Institution.

Um die Wirksamkeit der Reinigung und Desinfektion zu gewährleisten, beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung des Reinigungsmittels.

In dieser Phase sollte besonderes Augenmerk auf sensible Bereiche und/oder schwer zugängliche gelegt werden, damit Reinigungsprodukt und -wirkung optimal entfalten können.

Als Erstes ist es wichtig, überschüssige Flüssigkeiten und Körpergewebe mit einem fusselfreien Einwegtupfer zu entfernen.

Die Medizinprodukte werden dann auf ein Tablett mit destilliertem Wasser gelegt oder mit einem feuchten Tuch abgedeckt.

Automatisches Reinigungs/Desinfektionsverfahren:

Die Instrumente in den Korb eines Wasch-/Desinfektionsautomaten gemäß den Anweisungen des Herstellers legen und entsprechend dem für Zubehör von OSD empfohlenen und im Folgenden beschriebenen Zyklus behandeln:

- **Vorreinigung**

- Gegebenenfalls Instrumente auseinanderbauen.
- Mindestens 5 Minuten in kaltes Leitungswasser eintauchen.
- Die Oberfläche mit einer Nylonbürste bürsten bis die sichtbaren Verunreinigungen verschwunden sind.
- 20 Sekunden unter Druckstrahl (zwischen 3 und 4 bar bzw. 43,5 und 58 psi) abspülen und dabei besonders auf die Kanülen achten.

- **Wasch-/Desinfektionsgerät**

Verwenden Sie ein Reinigungs-/Desinfektionsgerät vom Typ Miele G7735 CD sowie dessen Vario TD Programm gemäß diesen Schritten:

- 2 Minuten Vorreinigung in kaltem Wasser
- Abpumpen.
- 5-minütige Reinigung in entionisiertem Wasser bei 55 ° C und 0,5% mildes alkalisches Reinigungsmittel, (Beispiel: NeodisherMediClean - DR.WEIGERT).
- Abpumpen.
- 3-minütige Spülung und Neutralisierung mit demineralisiertem Wasser.
- Abpumpen.
- 2 Min. Endspülung mit kaltem demineralisiertem Wasser
- Abpumpen.
- Trocknung, fusselfreies, sauberes, d.h. steriles Trockentuch.

Prüfen Sie, dass sich auf den Instrumenten und in den Öffnungen keine Verschmutzungen mehr befinden.
Falls erforderlich, wiederholen Sie den Reinigungszyklus.
Nach der Reinigung/Desinfektion müssen die zerlegten Instrumente zusammengesetzt und visuell inspiziert werden.

- **Inspektion vor der Sterilisation:**

Sorgfältig jedes Medizinprodukt überprüfen Sie die Entfernung aller sichtbaren Verunreinigungen zu gewährleisten. Falls erforderlich, wiederholen Sie den Vorgang der Reinigung und Desinfektion.
Prüfen Sie, dass die Instrumente nicht deformiert sind.

- **Sterilisation:**

Die medizinischen Einrichtungen sind verantwortlich dafür, dass das Zubehör steril ist und bleibt. Die Dampfsterilisation/feuchte Wärme ist die bevorzugte Methode.

Allerdings steht Ihnen der Vertrieb von OSD für weitere Informationen zur Verfügung.

Die Maßnahmen zum Schutz vor scharfen Kanten oder potenziell verletzenden Instrumenten müssen auch von der medizinischen Einrichtung beachtet werden.

OSD rät die Empfehlungen des Herstellers des Sterilisators zu beachten, die unbedingt befolgt werden sollten. Wenn mehrere Instrumenten-Sets in einem Sterilisationszyklus sterilisiert werden, ist es wichtig, sicherzustellen, dass die vom Hersteller angegebene maximale Ladung nicht überschritten wird.

Die Instrumenten-Sets sollten ordnungsgemäß aufbereitet und auf Tablett und/oder in Kästen verpackt werden, damit der Dampf eindringen und in direkten Kontakt mit allen Oberflächen kommt.

Bitte beachten Sie die folgenden Informationen für Parameter der Sterilisationszyklen, die von OSD validiert wurden, um einen Sterilitätssicherheitswert von 10^{-6} zu bieten.

Sterilisationsverfahren mit Ethylenoxid oder Plasma sollten nicht angewendet werden.

Geprüfte Parameter der Dampfsterilisation:

Zyklustyp: Vorvakuum - Temperatur 134 °C (273,2 °F)

Expositionsdauer: 18 Minuten - Trocknungszeit: 20 Minuten

REPARATUREN

Ein beschädigtes Medizinprodukt darf nicht mehr verwendet werden und muss zur Reparatur an OSD zurückgeschickt werden.

Um die Verantwortlichen der Reparatur zu schützen, können die Instrumente nur zur Reparatur zurückgeschickt werden, wenn diese Dekontaminations-/Reinigungs-/Sterilisationsverfahren unterzogen wurden. Wenn das Zubehör verschmutzt ist oder wenn Modifikationen an den zu reparierenden Produkten zu finden sind, behält OSD sich das Recht vor, diese Medizinprodukte auf Ihre Kosten zu reparieren oder die Reparatur vollständig zu verweigern.

OSD ist im Fall von Änderungen oder Reparaturen an den Medizinprodukten durch die Institution nicht verantwortlich.

ENTSORGUNG

Bei Bedarf kann das Medizinprodukt gemäß guter Praxis zur Entsorgung von infektiösem medizinischen Abfall entsorgt werden. Es liegt kein besonderes oder ungewöhnliches Risiko im Zusammenhang mit der Entsorgung dieses Medizinproduktes vor.

RÜCKSENDUNG

Die medizinische Einrichtung muss die Leihinstrumente (komplette Box oder Einzelinstrument) vor Rückversand an OSD desinfizieren, reinigen, sterilisieren und angemessen verpacken.

Außerdem muss die medizinische Einrichtung, wenn sie nicht Eigentümer des Medizinproduktes ist, die Rechnung hierfür übernehmen und alle notwendigen Vorkehrungen treffen, um die Zahlung in folgenden Fällen vorzunehmen:

- Wenn das Medizinprodukte unter Umständen verwendet werden soll, unter denen der Verdacht auf Kontakt mit NCTA (Patienten oder chirurgisches Risiko) besteht;

- Wenn eine Vernichtung des Medizinproduktes unter der Einhaltung von Hygienevorschriften und bei Einhaltung der in diesem Handbuch für die Lagerung, Dekontamination, Reinigung und Sterilisation erwähnten Hinweise von OSD und die eine Schädigung des Materials hervorruft, vorgeschrieben ist.

GARANTIE








Das Unternehmen OSD sorgt dafür, dass diese gelieferten Produkte den damit verbundenen Spezifikationen entsprechen. Darüber hinaus gilt diese Garantie nicht im Fall von Missbrauch oder unsachgemäßer Handhabung des Medizinprodukts gilt. OSD übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung von zusätzlichem Zubehör, das während der Implantation des Medizinproduktes SAXXO verwendet wird.

Jedes defekte Instrument muss an OSD zurückgeschickt werden, um ersetzt bzw. vernichtet zu werden.

Dieses Handbuch muss zugänglich sein und griffbereit in der Nähe der Instrumente aufbewahrt werden. OSD wird keine Haftung für Schäden übernehmen können, die durch eine nicht sachgemäße Verwendung und/oder Handhabung des Medizinproduktes entstehen und im Fall von Reparaturen und/oder Modifikationen am Instrument, die durch eine nicht autorisierte Person vorgenommen wurde.

Das Unternehmen OSD verbürgt sich nicht für das klinische Ergebnis, wohl wissend, dass Restrisiken den Erfolg der Operation gefährden können.


Um eine optimale Nutzung der Medizinprodukte zu gewährleisten, sollten die folgenden Symbolen beachtet werden:

Symbole auf						
						
Siehe Gebrauchsanleitung	Hersteller	Nicht steril	Darf bei beschädigter Umverpackung nicht verwendet werden	Katalognummer	Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren	Vor Feuchtigkeit schützen

**ORTHOPAEDIC & SPINE
DEVELOPMENT**
 Chemin de Fontanille - BP 11211

 84911 AVIGNON Cedex 9 - FRANCE
 Tél : +33 (0)4.32.74.01.10
 Fax : +33 (0)4.90.80.02.39
info@osdevelopment.fr
www.osdevelopment.fr

Βοηθητικό υλικό SAXXO

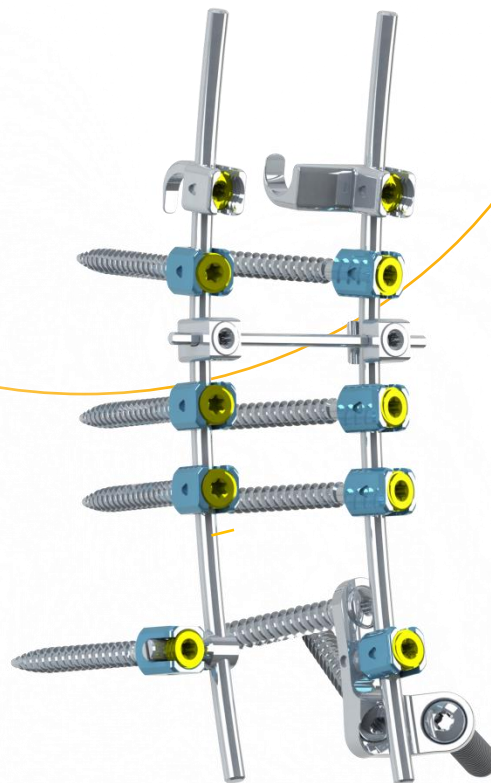

Γενικές οδηγίες

Η OSD συνιστά να κοινοποιηθούν οι παρούσες οδηγίες χρήσης στο σύνολο του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού που θα έρθει σε επαφή με το βοηθητικό υλικό.

Η χρήση του βοηθητικού υλικού απαιτεί γνώσεις της ανατομίας, της εμβιομηχανικής και της χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης. Το βοηθητικό υλικό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από αναγνωρισμένους επαγγελματίες χειρουργούς που εξασκούν τη σχετική χειρουργική ειδικότητα, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα υφιστάμενα διαθέσιμα δεδομένα της χειρουργικής επιστήμης και τέχνης.

Περιγραφή

Το βοηθητικό υλικό περιλαμβάνει εργαλεία (καθαυτό βοηθητικό υλικό), θήκες τακτοποίησης και έναν περιέκτη.

Είναι απαραίτητο να εξοικειωθείτε με τη χειρουργική τεχνική και, σε περίπτωση αμφιβολίας, να επικοινωνήσετε με την εταιρεία OSD για κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με τη χρήση του βοηθητικού υλικού και των σχετιζόμενων εμφυτευμάτων.

Ορισμένα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται στο τυπικό σετ, αλλά μπορείτε να τα προμηθευτείτε κατόπιν αιτήματος.

Κανένα βοηθητικό υλικό ή στοιχείο βοηθητικού υλικού δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφυτεύεται.

Το βοηθητικό υλικό μπορεί να έχει κατασκευαστεί από ανοξείδωτο χάλυβα, κράμα τιτανίου, πολυμερές ή σιλκόνη.

Τα υλικά είναι βιοσυμβατά, ωστόσο οποιαδήποτε τροποποίηση των προϊόντων μπορεί να επηρεάσει τις τεχνικές και βιολογικές τους επιδόσεις.

Ενδείξεις

Το βοηθητικό υλικό της OSD έχει σχεδιαστεί ειδικά για να διευκολύνει την τοποθέτηση ή την αφαίρεση των εμφυτευμάτων SAXXO και πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αυτό το σκοπό.

Η μονάδα υγείας είναι υπεύθυνη για την προαπολύμανση, τον καθαρισμό και την αποστείρωση του βοηθητικού υλικού με επικυρωμένες μεθόδους μετά τη χρήση. Οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν δεν υποκαθιστούν τους ισχύοντες υγειονομικούς κανονισμούς: πρότυπα, καλές πρακτικές, κατευθυντήριες οδηγίες, εθνικές συστάσεις, υπουργικά διατάγματα κ.λπ.

Αντενδείξεις

Γνωστή αλλεργία σε οποιοδήποτε υλικό κατασκευής του βοηθητικού ιατροτεχνολογικού προϊόντος (ιδίως στο νικέλιο).

Οι αντενδείξεις σχετίζονται κυρίως με το ιατροτεχνολογικό προϊόν SAXXO (οδηγίες χρήσης ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ SAXXO: Rev_20170615_SAX_IFU).

Η OSD αποποιείται κάθε ευθύνη αν δεν τηρηθούν οι ενδείξεις και οι αντενδείξεις χρήσης του βοηθητικού υλικού και των εμφυτευμάτων SAXXO.

Έλεγχος και επαλήθευση της καλής λειτουργίας των βοηθητικών υλικών SAXXO

Για να αποφευχθεί δυναμικός τραυματισμός του ασθενή και του χρήστη, το εργαλείο πρέπει πάντα να ελέγχεται κατά την παραλαβή και πριν από κάθε χρήση. Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά μπορεί να συνεπάγεται κίνδυνο δυσλειτουργίας.

Τα σετ εργαλείων πρέπει να ελέγχονται σχολαστικά κατά την παραλαβή τους.

Ο κωδικός αναφοράς του βοηθητικού υλικού αναγράφεται πάνω στο προϊόν.

Θα πρέπει επίσης να επαληθεύεται ότι η συσκευασία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν το σετ βοηθητικού υλικού, καθώς και ενδεχόμενα διαφορετικά μεγέθη (π.χ.: κοχλιοτόμοι), με βάση τις οδηγίες και τις απαιτήσεις που έχει καθορίσει ο χειρουργός.

Λίστα με το παραδοθέν υλικό έχει επισυναφθεί μαζί με το βοηθητικό υλικό κατά την αποστολή.

Αν κάποιο εργαλείο πρέπει να συνδεθεί με άλλο εργαλείο κατά τη χειρουργική επέμβαση, θα πρέπει να επαληθεύσετε ότι τα στοιχεία έχουν συναρμολογηθεί σωστά. Ελέγξτε τα κινούμενα μέρη (π.χ., λαβίδες) για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά. Αναλυτικές οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της OSD: <http://www.osdevelopment.fr>

Ελέγξτε προσεκτικά κάθε επιμέρους υλικό για να βεβαιωθείτε ότι δεν φέρει καμία ορατή ακαθαρσία, ζημιά και/ή υπερβολική φθορά.

Αν υπάρχει ορατή ακαθαρσία, επιβάλλεται να επαναληφθεί η διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης.

Κάθε προϊόν που φέρει ζημιά πρέπει να αποσύρεται και να επιστρέφεται στην OSD.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Αλλεργία σε οποιοδήποτε υλικό κατασκευής του βοηθητικού ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

Ανεπιθύμητες ενέργειες των εμφυτευμάτων SAXXO (οδηγίες χρήσης ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ SAXXO: Rev_20170615_SAX_IFU)

• Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις κατά το χειρισμό των προϊόντων, ιδιαίτερα αν διαθέτουν αιχμηρές ακμές ή αιχμηρά μέρη.

Για εργαλεία που διατίθενται μεμονωμένα: μετά την παραλαβή και πριν από τον καθαρισμό και την αποστείρωση, πρέπει να αφαιρείται η πλαστική σακούλα.

Τα αρθρωτά εργαλεία (λαβίδες) πρέπει να ανοίγονται για πιο αποτελεσματικό καθαρισμό.

Για να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα και η ασφάλεια του υλικού, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες συστάσεις:

- Η συσκευασία πρέπει να ανοίγεται κοντά στο χειρουργικό πεδίο.
- Ο χειρισμός των ιατροτεχνολογικών προϊόντων πρέπει να πραγματοποιείται με προσοχή.
- Συνιστάται να μην χρησιμοποιούνται βούρτσες, μεταλλικά σφουγγαράκια ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο που μπορεί να αλλοιώσει το βοηθητικό υλικό κατά τον καθαρισμό με το χέρι.
- Συνιστάται να χρησιμοποιούνται μαλακές νάιλον βούρτσες.
- Να αποφεύγεται η χρήση χημικών προϊόντων με βάση το χλώριο, οξέα, οργανικούς ή αμμωνιακούς διαλύτες.
- Να αποφεύγεται η χρήση χημικών προϊόντων με βάση το ανθρακικό νάτριο (σόδα) για τους περιέκτες.
- Να αποφεύγεται η χρήση οξέος για την εξουδετέρωση των αλκαλικών υπολειμμάτων στο τέλος του αυτόματου κύκλου πλύσης για τους δίσκους αλουμινίου και τα εργαλεία με στοιχεία από πολυμερές υλικό.
- Γενικά, θα πρέπει να ελέγχετε πάντα αν λείπει κάποιο εξάρτημα: είτε έχει χαθεί είτε έχει σπάσει, επικοινωνήστε με την OSD.
- Μην αφήνετε τα εργαλεία να στεγνώσουν μετά τη χρήση. Αν στεγνώσουν, οι ακαθαρσίες θα καθαρίζονται πιο δύσκολα.
- Μην χρησιμοποιείτε ορυκτέλαια ή λιπαντικά με βάση τη σιλικόνη διότι περικλείουν τους μικροοργανισμούς, εμποδίζουν την άμεση επαφή της επιφάνειας με τον ατμό και αφήνουν κατάλοιπα που απομακρύνονται δύσκολα.
- Μην τροποποιείτε τα εργαλεία.
- Ο φυσιολογικός ορός και τα καθαριστικά/ απολυμαντικά που περιέχουν αλδεΐδες, υδράργυρο, ενεργό χλώριο, χλωρίδια, βρώμιο, βρωμίδια, ιώδιο ή ιωδιδία είναι διαβρωτικά και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.
- Συνιστάται η χρήση καθαριστικών και ενζυματικών προϊόντων με ουδέτερο pH.

Σημείωση: Ο ορθοπαιδικές πράξεις θεωρείται ότι δεν ενέχουν κίνδυνο μετάδοσης μη συμβατικών μολυσματικών παραγόντων (NCTA). Μόνο τα εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με υποψία ή παρουσία μεταδοτικής σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας πριν από την επεμβατική πράξη πρέπει να υποβάλλονται σε πλήρη εξουδετέρωση με διάλυμα ανθρακικού νατρίου (1N) ή υποχλωριώδους νατρίου, με συγκέντρωση ενεργού χλωρίου 2%.

• Προφυλάξεις/ επανεπεξεργασία

Πρέπει οπωσδήποτε να απομακρύνεται η περίσσεια οργανικών υγρών και ιστών από τα εργαλεία με πανάκια μίας χρήσης που δεν αφήνουν χνούδι.

Πριν από τον καθαρισμό των εργαλείων, συνιστάται να μην αφήνετε να στεγνώνουν πάνω στα εργαλεία αλατούχα διαλύματα, αίμα, οστικά θραύσματα, υπολείμματα ιστών ή άλλα οργανικά υπολείμματα.

Τοποθετήστε τα εργαλεία σε λεκάνη με αποσταγμένο νερό ή σε δίσκο καλυμμένο με υγρές πετσέτες.

Κατά το χειρισμό μολυσμένων προϊόντων θα πρέπει να φοράτε εξάρτηση ατομικής προστασίας.

• Προαπολύμανση

Σκοπός της προαπολύμανσης είναι να περιοριστεί ο πληθυσμός των μικροοργανισμών, ώστε να διευκολυνθεί ο περαιτέρω καθαρισμός του υλικού. Παράλληλα, προστατεύει το προσωπικό κατά το χειρισμό των υλικών και αποτρέπει τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Όλα τα επαναχρησιμοποιήσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει να υποβάλλονται αμέσως σε προαπολύμανση ή να τοποθετούνται χωρίς καθυστέρηση σε πλυντήριο-απολυμαντήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι περιέκτες και οι δίσκοι τακτοποίησης δεν πρέπει να έρχονται σε παρατεταμένη επαφή με αυτό τον τύπο απολυμαντικού. Καθαρίστε την ακάθαρτη περιοχή και ξεπλύνετε αμέσως.

- **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Είναι απαραίτητο να τηρούνται οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στα ακόλουθα επίσημα έγγραφα:

- Γαλλική οδηγία DGS/RI3/2001/449 της 1ης Δεκεμβρίου 2011 που αφορά την επικαιροποίηση των συστάσεων για τον περιορισμό των κινδύνων μετάδοσης μη συμβατικών μολυσματικών παραγόντων κατά τη διενέργεια επεμβατικών πράξεων.
- Γαλλική εγκύκλιος DGS/SD5C/DHOS/2005/435 της 23ης Σεπτεμβρίου 2005 που αφορά τις συστάσεις για την επεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων που έχουν χρησιμοποιηθεί σε άτομα στα οποία χορηγήθηκαν ασταθή προϊόντα αίματος από δότες που εκ των υστέρων διαγνώστηκαν με παραλλαγή της νόσου Creutzfeld-Jakob (vMCJ).

Οδηγίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης:

- **Καθαρισμός/απολύμανση:**

Τα επαναχρησιμοποιήσιμα βοηθητικά υλικά πρέπει υποχρεωτικά να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται με την ενδεδειγμένη διαδικασία πριν από την αποστείρωσή τους.

Στόχος αυτού του βήματος είναι να απομακρυνθούν όλες οι ακαθαρσίες και τα υπολείμματα που έχουν μείνει πάνω στα βοηθητικά υλικά μετά την ιατρική πράξη, έτσι ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των βιώσιμων μικροοργανισμών στα υλικά πριν από την αποστείρωσή τους.

Οι μέθοδοι καθαρισμού και απολύμανσης που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι οι εξής: καθαρισμός με το χέρι και αυτόματος καθαρισμός.

Η επιλογή των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν εναπόκειται στη μονάδα υγείας.

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του καθαρισμού και της απολύμανσης, τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του καθαριστικού προϊόντος.

Σε αυτό το βήμα, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς και/ή δύσκολα προσβάσιμες περιοχές, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη δράση του καθαριστικού προϊόντος.

Αρχικά, πρέπει οπωσδήποτε να απομακρύνετε την περίσσεια οργανικών υγρών και ιστών με πανάκι μίας χρήσης που δεν αφήνει χνούδι. Κατόπιν, τοποθετήστε τα προϊόντα σε δίσκο με αποσταγμένο νερό ή σκεπάστε τα με μια υγρή πετσέτα.

Διαδικασία αυτόματου καθαρισμού/απολύμανσης:

Τοποθετήστε τα εργαλεία στο καλάθι κατάλληλου πλυντηρίου/ απολυμαντήρα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, και υποβάλλετε σε επεξεργασία στον κύκλο που συνιστά η OSD για τα βοηθητικά υλικά και περιγράφεται παρακάτω:

- **Αρχικός καθαρισμός**

- Αποσυναρμολογήστε τα εργαλεία, αν χρειάζεται.
- Βυθίστε τα για τουλάχιστον 5 λεπτά σε κρύο νερό βρύσης.
- Τρίψτε τις επιφάνειες με νάιλον βούρτσα μέχρι να απομακρυνθούν όλες οι ορατές ακαθαρσίες.
- Ξεπλύνετε για 20 δευτερόλεπτα κάτω από νερό υπό πίεση (μεταξύ 3 και 4 bar ή 43,5 και 58 psi), επιμένοντας ιδιαίτερα στις κάνουλες.

- **Πλυντήριο/απολυμαντήρας**

Χρησιμοποιήστε πλυντήριο/ απολυμαντήρα τύπου MIELE G7735 CD στο πρόγραμμα Vario TD, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

- 2 λεπτά πρόπλυση με κρύο νερό
- Εκκένωση
- 5 λεπτά πλύση με απιονισμένο νερό στους 55 °C, με ήπιο αλκαλικό απορρυπαντικό 0,5% (π.χ.: NeodisherMediClean - Dr.Weigert)
- Εκκένωση
- 3 λεπτά έκπλυση και εξουδετέρωση με απιονισμένο νερό
- Εκκένωση
- 2 λεπτά τελική έκπλυση με απιονισμένο νερό
- Εκκένωση
- Στέγνωμα με στεγνό πανί, που δεν αφήνει χνούδι, καθαρό ή αποστειρωμένο



Επαληθεύστε ότι δεν υπάρχει ίχνος ακαθαρσίας στα εργαλεία και στους αυλούς.

Αν χρειάζεται, επαναλάβετε τον κύκλο καθαρισμού.

Μετά τον καθαρισμό/ απολύμανση, επανασυναρμολογήστε τα αποσυναρμολογημένα εργαλεία και ελέγξτε τα οπτικά.

- **Έλεγχος πριν από την αποστείρωση:**

Ελέγξτε προσεκτικά κάθε υλικό για να βεβαιωθείτε ότι έχει απομακρυνθεί κάθε ορατή ακαθαρσία. Αν χρειάζεται, επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης.

Επίσης, επαληθεύστε ότι τα εργαλεία δεν έχουν υποστεί καμία παραμόρφωση.

- **Αποστείρωση:**

Η μονάδα υγείας είναι υπεύθυνη για την αποστείρωση και τη διατήρηση της στειρότητας των βοηθητικών υλικών. Συνιστώμενη μέθοδος είναι η αποστείρωση με ατμό/ υγρή θερμότητα.

Σε κάθε περίπτωση, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της OSD είναι στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία.

Η μονάδα υγείας είναι επίσης υπεύθυνη να λάβει τα αναγκαία μέτρα προστασίας από αιχμηρές ακμές ή αιχμηρά μέρη των εργαλείων, που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

Η OSD συνιστά να τηρούνται πάντα οι συστάσεις του κατασκευαστή της συσκευής αποστείρωσης. Κατά την αποστείρωση πολλαπλών σετ εργαλείων σε έναν κύκλο αποστείρωσης, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει υπέρβαση του μέγιστου ορίου που συνιστά ο κατασκευαστής.

Τα σετ εργαλείων πρέπει να προετοιμάζονται και να συσκευάζονται σωστά μέσα στους δίσκους και/ή στις κασετίνες, ώστε να μπορεί να εισχωρήσει ο ατμός και να έρθει σε επαφή με όλες τις επιφάνειες.

Ανατρέξτε στις ακόλουθες πληροφορίες για τις παραμέτρους των κύκλων αποστείρωσης που έχουν επικυρωθεί από την OSD, ώστε να παρέχουν επίπεδο διασφάλισης στειρότητας (SAL) 10^{-6} .

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μέθοδοι αποστείρωσης με αιθυλενοξειδίο ή πλάσμα.

Επικυρωμένες παράμετροι αποστείρωσης με ατμό:

Τύπος κύκλου: δημιουργία κενού προ της αποστείρωσης - Θερμοκρασία 134 °C (273,2 °F).

Διάρκεια έκθεσης: 18 λεπτά - Χρόνος στεγνώματος: 20 λεπτά.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Κάθε προϊόν που έχει υποστεί ζημιά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται περαιτέρω και πρέπει να επιστρέφεται στην OSD για επισκευή.

Για να προστατευτούν τα άτομα που θα πραγματοποιήσουν την επισκευή, δεν πρέπει να αποστέλλονται για επισκευή εργαλεία που δεν έχουν προηγουμένως υποβληθεί στις διαδικασίες απολύμανσης/ καθαρισμού/ αποστείρωσης. Αν τα βοηθητικά υλικά είναι ακάθαρτα ή τα προϊόντα προς επισκευή έχουν τροποποιηθεί, η OSD διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει αυτά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα με δικά σας έξοδα ή να αρνηθεί τελείως την επισκευή.

Η OSD αποποιείται κάθε ευθύνη αν τα προϊόντα έχουν τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από τη μονάδα υγείας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Αν χρειαστεί, το προϊόν μπορεί να απορριφθεί σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές απόρριψης δυνητικά μολυσματικών αποβλήτων που προέρχονται από νοσηλευτικές δραστηριότητες. Η απόρριψη αυτού του προϊόντος δεν συνεπάγεται ειδικούς ή ασυνήθεις κινδύνους.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η μονάδα υγείας πρέπει να απολυμάνει, να καθαρίσει, να αποστειρώσει και να συσκευάσει κατάλληλα τα μισθωμένα βοηθητικά υλικά (πλήρης κασετίνα ή μεμονωμένο εργαλείο) πριν τα επιστρέψει στην OSD.

Επίσης, αν η μονάδα υγείας δεν έχει την κυριότητα του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, η μονάδα υγείας αποδέχεται να χρεωθεί το προϊόν και δεσμεύεται ότι θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να το εξοφλήσει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Αν το ιατροτεχνολογικό προϊόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες όπου υπάρχει υποψία επαφής με μη συμβατικούς μολυσματικούς παράγοντες (NCTA) (μέσω του ασθενή ή της χειρουργικής πράξης),








- Αν επιβάλλεται η καταστροφή του ιατροτεχνολογικού προϊόντος από τους υγειονομικούς κανονισμούς, καθώς και αν έχει υποστεί φθορά το υλικό επειδή δεν τηρήθηκαν οι συστάσεις της OSD που περιλαμβάνονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης όσον αφορά τη φύλαξη, την απολύμανση, τον καθαρισμό και την αποστείρωση του προϊόντος.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εταιρεία OSD εγγυάται ότι τα παραδοθέντα προϊόντα της πληρούν τις προδιαγραφές που τους έχουν αποδοθεί. Ωστόσο, αυτή η εγγύηση δεν ισχύει αν το προϊόν έχει υποστεί ακατάλληλη χρήση ή ακατάλληλο χειρισμό. Η OSD αποποιείται κάθε ευθύνη αν χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά παρελκόμενα κατά την εμφύτευση του υλικού SAXXO. Κάθε ελαττωματικό εργαλείο πρέπει να επιστρέφεται στην OSD για να αντικατασταθεί ή να καταστραφεί. Οι παρούσες οδηγίες χρήσης θα πρέπει να φυλάσσονται σε άμεση πρόσβαση και κοντά στα αντίστοιχα εργαλεία. Η OSD δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση και/ή σε ακατάλληλο χειρισμό του προϊόντος, καθώς και αν το εργαλείο έχει επισκευαστεί και/ή έχει τροποποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένο άτομο. Η εταιρεία OSD δεν εγγυάται το κλινικό αποτέλεσμα, καθόσον γνωρίζει ότι η επιτυχία της χειρουργικής επέμβασης μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από υπολειπόμενους κινδύνους.

Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση των προϊόντων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν τα ακόλουθα σύμβολα:

Χρησιμοποιούμενα σύμβολα						
						
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης	Κατασκευαστής	Μη στείρο	Να μην χρησιμοποιείται αν έχει υποστεί ζημιά η συσκευασία	Αρ. καταλόγου	Να φυλάσσεται μακριά από το φως του ήλιου	Μακριά από υγρασία

**ORTHOPAEDIC & SPINE
DEVELOPMENT**
Chemin de Fontanille - BP 11211

84911 AVIGNON Cedex 9 - FRANCE

Tél : +33 (0)4.32.74.01.10


Fax : +33 (0)4.90.80.02.39

info@osdevelopment.fr

www.osdevelopment.fr

ISTRUZIONI PER L'USO

Ancillare SAXXO

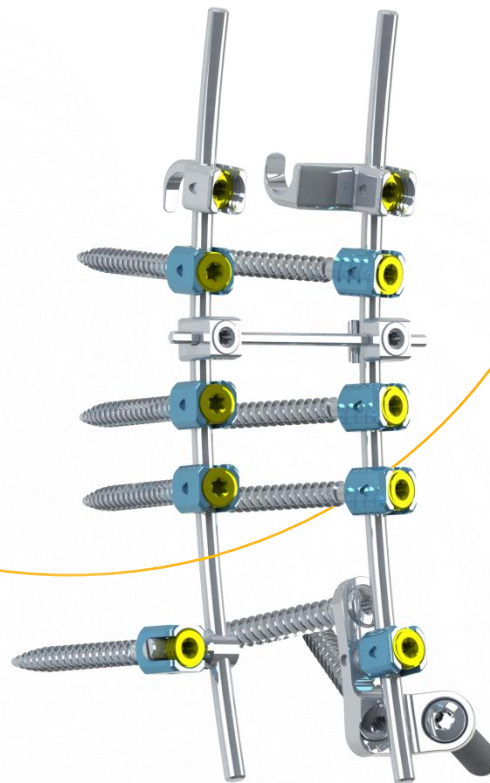

Informazioni generali

OSD consiglia al personale sanitario che lavora a contatto con i dispositivi ancillari di acquisire una buona conoscenza delle presenti istruzioni per l'uso.

L'utilizzo dei dispositivi ancillari richiede familiarità con l'anatomia, la biomeccanica e la chirurgia del rachide. I dispositivi ancillari possono essere utilizzati esclusivamente da chirurghi qualificati che eseguano questo tipo di interventi in base ai dati attualmente disponibili in campo scientifico e chirurgico.

Descrizione

L'ancillare comprende la strumentazione (dispositivi ancillari), le relative custodie e un contenitore.

È necessario acquisire una buona conoscenza della tecnica chirurgica. In caso di dubbi, contattare il rappresentante della società OSD per ricevere tutte le informazioni necessarie all'utilizzo dei dispositivi ancillari e degli impianti correlati.

Alcuni strumenti non vengono forniti con la serie standard, ma possono essere resi disponibili su richiesta.

In nessun caso un ancillare o un relativo componente dovrà essere impiantato.

I dispositivi ancillari sono realizzati in acciaio inossidabile, lega di titanio, polimero o silicone.

I materiali sono biocompatibili. Ogni modifica apportata ai dispositivi può comprometterne le prestazioni tecniche e biologiche.

Indicazioni

I dispositivi ancillari OSD sono stati realizzati appositamente per facilitare il posizionamento e l'espanto degli impianti SAXXO e vanno utilizzati esclusivamente a questo scopo.

È responsabilità della struttura sanitaria procedere alla pre-disinfezione, pulizia e sterilizzazione dell'ancillare dopo l'uso, in base alle procedure approvate. Le presenti raccomandazioni non sostituiscono le regolamentazioni sanitarie in vigore, come norme, buone pratiche, linee guida, raccomandazioni nazionali, documenti ministeriali ecc.

Controindicazioni

Allergia nota a uno dei componenti dei dispositivi ancillari (generalmente il nickel).

Le controindicazioni sono associate principalmente al dispositivo SAXXO (istruzioni degli IMPIANTI SAXXO: Rev_20170615_SAX_IFU).

OSD declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle indicazioni e controindicazioni relative all'ancillare e agli impianti SAXXO.

Ispezione e verifica del funzionamento degli ancillari SAXXO

Allo scopo di evitare lesioni ai pazienti e agli utenti, è necessario effettuare sempre un controllo al momento della ricezione dei dispositivi e prima di ogni utilizzo. Ogni eventuale deterioramento può compromettere la funzionalità dei dispositivi.

Al momento della ricezione, le serie dei dispositivi deve essere esaminata in modo accurato.

Su ogni dispositivo è riportato il codice prodotto.

È inoltre importante verificare la disponibilità dell'insieme dei dispositivi, eventualmente anche delle diverse misure di ogni serie (ad esempio, dei maschiatori), in base alle istruzioni e alle esigenze formulate dal chirurgo.

Ogni spedizione è accompagnata da un elenco dei dispositivi consegnati.

Data la correlazione reciproca tra gli strumenti nel corso della procedura chirurgica, è necessario verificare il corretto assemblaggio dei dispositivi. Controllare l'azionamento dei componenti mobili (ad esempio, delle pinze) per verificarne il buon funzionamento. Le caratteristiche specifiche e le modalità d'uso sono disponibili sul sito internet di OSD: <http://www.osdevelopment.fr>

Ispezionare con cura ogni dispositivo, per assicurarsi di aver rimosso completamente ogni contaminazione visibile e di aver identificato ogni danneggiamento e/o usura eccessiva.

In caso di contaminazione visibile, è indispensabile ripetere la procedura di pulizia e disinfezione.

Ogni dispositivo danneggiato dovrà essere isolato e restituito a OSD.

Effetti indesiderati

Allergia nota a uno dei componenti dei dispositivi ancillari.

Effetti indesiderati degli impianti SAXXO (istruzioni sugli IMPIANTI SAXXO: Rev_20170615_SAX_IFU)

- **Avvertenze e precauzioni**

Durante la manipolazione degli ancillari, è necessario adottare una serie di precauzioni, soprattutto per i dispositivi appuntiti o taglienti.

In caso di strumenti in confezione singola, al momento della ricezione è necessario rimuovere l'involucro di plastica prima della pulizia e sterilizzazione.

Gli strumenti articolati (pinze) devono essere aperti, allo scopo di migliorare l'efficacia del lavaggio.

Per garantire il buon funzionamento e la sicurezza dei dispositivi, è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:

- L'apertura della confezione deve essere effettuata in prossimità del campo operatorio.
- I dispositivi devono essere maneggiati con cautela.
- Durante le procedure di pulizia manuale, evitare l'uso di spazzolini o spugnette in metallo, e di ogni strumento in grado di alterare i dispositivi ancillari.
- Privilegiare l'uso di spazzolini a setole morbide di nylon.
- Evitare l'uso di prodotti chimici a base di cloro, acidi, solventi organici o ammoniaca.
- Per i contenitori deve essere evitato l'uso di prodotti chimici a base di soda.
- Al termine del ciclo di lavaggio automatico, per i vassoi in alluminio e per gli strumenti che comprendono parti polimeriche, evitare l'uso di acidi per la neutralizzazione dei residui alcalini.
- In linea generale, è necessario prestare attenzione ad ogni singolo componente. Qualora un componente venisse a mancare, se perduto o danneggiato, vi invitiamo a contattare OSD.
- Non lasciare asciugare gli strumenti dopo l'uso: i dispositivi sporchi sono più difficili da pulire quando sono asciutti.
- Non utilizzare oli minerali o lubrificanti a base di silicone, in quanto ricoprono i microrganismi, impediscono il contatto diretto del vapore con la superficie dei dispositivi e sono difficili da rimuovere.
- Non apportare modifiche agli strumenti.
- Il siero fisiologico e i detergenti e disinfettanti contenenti aldeide, mercurio, cloro attivo, cloruro, bromuro, iodio o ioduro sono corrosivi e non devono essere utilizzati.
- Si consiglia l'uso di detergenti enzimatici a pH neutro.

Nota: gli interventi ortopedici non sono considerati a rischio di agenti trasmissibili non convenzionali. L'inattivazione totale mediante soda caustica a una concentrazione di 1N, o tramite ipoclorito di sodio con cloro attivo al 2%, deve essere riservata unicamente agli strumenti utilizzati in precedenza su pazienti che presentavano encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), reale o presunta, prima dell'intervento invasivo.

- **Precauzioni / ricondizionamento**

È indispensabile rimuovere dagli strumenti gli eventuali residui di tessuti e liquidi organici, utilizzando una salvietta umidificata monouso e priva di pelucchi.

Si consiglia di non lasciar asciugare la soluzione fisiologica, il sangue, i frammenti ossei, tissutali o altri residui organici sugli strumenti prima della pulizia.

Collocare gli strumenti in una bacinella d'acqua distillata o in un vassoio coperto con salviette umidificate.

Il personale incaricato della manipolazione degli strumenti contaminati dovrà utilizzare gli appositi dispositivi di protezione.

- **Pre-disinfezione**

La pre-disinfezione ha lo scopo di ridurre la popolazione di microrganismi e di facilitare l'ulteriore pulizia. Ha inoltre l'obiettivo di proteggere il personale durante la manipolazione degli strumenti e di evitare la contaminazione ambientale. Tutti i dispositivi riutilizzabili devono essere sottoposti a una pre-disinfezione immediata o essere trattati immediatamente in un lavastrumenti/disinfettore.

ATTENZIONE: i contenitori e i vassoi non devono entrare in contatto prolungato con questo tipo di decontaminante. Pulire la zona sporca e risciacquare immediatamente.

- **Agenti infettivi non convenzionali**

È necessario attenersi alle disposizioni contenute nei seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva ministeriale francese DGS/RI3/2011/449 del 1° dicembre 2011, relativa all'aggiornamento delle raccomandazioni che mirano a ridurre il rischio di trasmissione degli agenti trasmissibili non convenzionali nel corso di interventi invasivi.
- Circolare ministeriale francese DGS/SD5C/DHOS/2005/435 del 23 settembre 2005, relativa alle raccomandazioni per il trattamento di dispositivi medici utilizzati dai soggetti che abbiano ricevuto prodotti ematici labili provenienti da donatori retrospettivamente affetti da varianti della malattia di Creutzfeld-Jakob (vMCJ).

Istruzioni di pulizia, disinfezione e sterilizzazione:

- **Pulizia / disinfezione**

La pulizia e la disinfezione, basate sulla procedura riportata più avanti, sono obbligatorie prima della sterilizzazione dei dispositivi ancillari riutilizzabili.

Questa fase ha lo scopo di rimuovere tutte le impurità e i residui dagli ancillari dopo l'intervento, riducendo così il numero di microrganismi attivi presenti sugli ancillari prima della sterilizzazione.

I metodi di pulizia e disinfezione attualmente utilizzati sono la pulizia manuale e la pulizia automatica. La scelta del metodo è sotto la responsabilità della struttura sanitaria.

Allo scopo di garantire l'efficacia della pulizia e della disinfezione, è necessario seguire le istruzioni dei prodotti per la pulizia. Durante questa fase, va riservata una particolare attenzione alle zone sensibili e/o di difficile accesso, in modo che l'operazione di pulizia dei prodotti sia ottimale.

In un primo momento, è indispensabile rimuovere i residui di tessuti e liquidi organici con un tampone monouso senza pelucchi. Quindi collocare i dispositivi in un vassoio contenente acqua distillata o coprirli con una salvietta umidificata.

Procedura di pulizia e disinfezione automatica:

Collocare gli strumenti nel cestello di un lavastrumenti/disinfettore adeguato, in base alle istruzioni del produttore, ed effettuare il trattamento mediante il ciclo consigliato per gli ancillari OSD, come descritto di seguito:

- **Pre-pulizia**

- Smontaggio degli strumenti, se necessario.
- Immersione per almeno 5 minuti in acqua fredda di rubinetto.
- Sfregamento delle superfici con uno spazzolino a setole di nylon, fino all'eliminazione delle impurità visibili.
- Risciacquo per 20 secondi con getto d'acqua a pressione (3-4 bar o 43,5-58 psi), soffermandosi sulle cannule.

- **Lavastrumenti/disinfettore**

Utilizzare un lavastrumenti/disinfettore MIELE G7735 CD, insieme al relativo programma Vario TD, articolato nel modo seguente:

- 2 minuti di pre-pulizia in acqua fredda.
- Svuotamento.
- 5 minuti di pulizia in acqua demineralizzata a 55 °C e 0,5% di detergente alcalino delicato (ad esempio: Neodisher MediClean - Dr.Weigert).
- Svuotamento.
- 3 minuti di risciacquo e neutralizzazione con acqua demineralizzata.
- Svuotamento.
- 2 minuti di risciacquo finale con acqua demineralizzata.
- Svuotamento.
- Asciugatura con un panno asciutto, senza pelucchi, pulito e preferibilmente sterile.

Verificare che gli strumenti e le relative parti cave non presentino più alcuna impurità.

Ripetere il ciclo di pulizia se necessario.

Dopo la pulizia e disinfezione, gli strumenti smontati dovranno essere rimontati e ispezionati visivamente.

- **Ispezione prima della sterilizzazione**

Ispezionare visivamente ogni dispositivo per confermare la rimozione di ogni contaminazione visibile. Se necessario, ripetere la procedura di pulizia e disinfezione.

Inoltre, verificare l'assenza di deformazione degli strumenti.

- **Sterilizzazione**

Il raggiungimento e la conservazione della sterilità sono sotto la responsabilità della struttura sanitaria. Il metodo consigliato è la sterilizzazione al vapore o al calore umido.

Tuttavia, il reparto commerciale di OSD è a vostra disposizione per ogni informazione aggiuntiva.

Rientra nella responsabilità della struttura sanitaria anche l'adozione dei criteri di protezione contro le parti appuntite o taglienti dei dispositivi.

OSD consiglia di rispettare le raccomandazioni del produttore dello sterilizzatore, che devono essere seguite in ogni caso. Quando si sterilizzano più serie di strumenti nello stesso ciclo, è importante assicurarsi di non superare il carico massimo indicato dal produttore.

Le serie di strumenti devono essere preparate e imballate correttamente nei vassoi o nelle scatole, per consentire al vapore di penetrare e di entrare in contatto diretto con tutte le superfici.

Fare riferimento alle informazioni riportate di seguito per i parametri di sterilizzazione dei cicli convalidati da OSD, allo scopo di garantire un livello di sicurezza della sterilità (SAL) pari a 10^{-6} .

Non utilizzare metodi di sterilizzazione all'ossido di etilene o al plasma.

Parametri convalidati per la sterilizzazione al vapore:

Tipo di ciclo: vuoto preliminare - Temperatura: 134 °C.

Durata dell'esposizione: 18 minuti - Tempo di asciugatura: 20 minuti.

RIPARAZIONI

Ogni dispositivo danneggiato non dovrà più essere utilizzato e dovrà essere restituito a OSD per la riparazione.

Allo scopo di proteggere il personale incaricato della riparazione, gli strumenti potranno essere restituiti per la riparazione solo dopo essere stati sottoposti alle procedure di decontaminazione, pulizia e sterilizzazione. Se gli ancillari sono sporchi o se si riscontrano delle modifiche ai prodotti da riparare, OSD si riserva il diritto di riparare tali dispositivi a spese del cliente o di rifiutare completamente la riparazione.

OSD declina ogni responsabilità in caso di modifiche o riparazioni effettuate sui dispositivi da parte della struttura sanitaria.

SMALTIMENTO

Se necessario, i dispositivi possono essere smaltiti secondo le abituali procedure di smaltimento dei rifiuti ospedalieri a rischio infettivo. Non esistono rischi speciali o inconsueti associati allo smaltimento di questi dispositivi.

RESTITUZIONE

La struttura sanitaria dovrà disinfettare, pulire, sterilizzare e imballare correttamente i dispositivi ancillari in prestito (scatole complete o strumenti isolati) prima di restituirli a OSD.

Inoltre, qualora la struttura sanitaria non fosse proprietaria dei dispositivi, ne accetterà la fatturazione e adotterà tutte le misure necessarie ad effettuare il pagamento nei seguenti casi:

- Quando i dispositivi sono destinati all'uso in circostanze per le quali esiste il sospetto di un contatto con agenti infettivi non convenzionali (paziente o intervento chirurgico a rischio).

- Quando si rende necessaria la distruzione dei dispositivi in osservanza delle norme sanitarie o in caso di deterioramento dei dispositivi provocato dal mancato rispetto delle raccomandazioni di OSD, incluse nelle presenti istruzioni, in materia di conservazione, decontaminazione, pulizia e sterilizzazione.

GARANZIA

La società OSD garantisce che i prodotti da essa consegnati sono conformi alle relative specifiche.








La presente garanzia non si applica in caso di utilizzo o manipolazione impropri dei dispositivi. OSD declina ogni responsabilità riguardo all'utilizzo di accessori aggiuntivi al momento dell'impianto dei dispositivi SAXXO.

Tutti gli strumenti difettosi dovranno essere restituiti a OSD per essere sostituiti o distrutti.

Le presenti istruzioni devono essere accessibili e conservate in prossimità della strumentazione. OSD non potrà essere ritenuta responsabile di danni risultanti da utilizzo e/o manipolazione impropri dei dispositivi e in caso di riparazioni e modifiche apportate agli strumenti da personale non autorizzato.

La società OSD non garantisce i risultati clinici, non escludendo la possibilità che l'esito di un intervento sia compromesso da rischi residui.

Per assicurare un utilizzo ottimale dei dispositivi, è necessario rispettare le indicazioni associate ai seguenti simboli:

Simboli utilizzati						
						
Consultare le Istruzioni per l'uso	Produttore	Non sterile	Non usare se l'involucro è danneggiato	Numero di catalogo	Conservare al riparo dalla luce solare.	Teme l'umidità

**ORTHOPAEDIC & SPINE
DEVELOPMENT**
Chemin de Fontanille - BP 11211

84911 AVIGNON Cedex 9 - FRANCE

Tél : +33 (0)4.32.74.01.10


Fax : +33 (0)4.90.80.02.39

info@osdevelopment.fr

www.osdevelopment.fr

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Equipamento auxiliar SAXXO

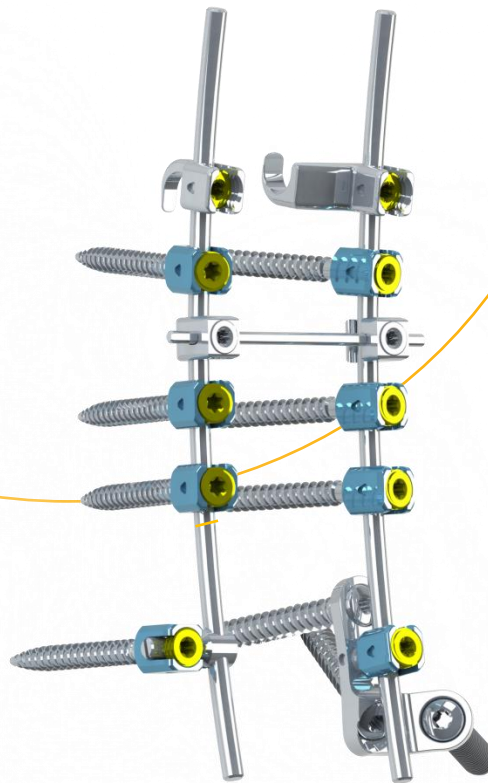

Aspetos gerais

A OSD recomenda que o conjunto dos funcionários em contacto com o equipamento auxiliar tome conhecimento da existência do manual de utilização.

A utilização do equipamento auxiliar exige conhecimentos de anatomia, de biomecânica e de cirurgia da coluna vertebral. O equipamento auxiliar só pode ser utilizado por um cirurgião qualificado que pratique esta cirurgia considerando os dados atualmente disponíveis da ciência e da técnica cirúrgica.

Descrição

O equipamento auxiliar é composto por instrumentos (material auxiliar), dispositivos de arrumação e um contentor.

É necessário conhecer a técnica operatória e, em caso de dúvida, contactar o representante da empresa OSD para obter todas as informações necessárias à utilização do equipamento auxiliar e implantes associados.

Por outro lado, certos instrumentos não são fornecidos com o conjunto padrão, podendo ser disponibilizados mediante pedido.

Em nenhum caso um equipamento auxiliar ou componente auxiliar pode ser implantado.

O material auxiliar pode ser fabricado em aço inoxidável, liga de titânio, polímero ou silicone.

Os materiais são biocompatíveis. Além disto, qualquer modificação feita nos dispositivos pode colocar em causa tantos os seus desempenhos técnicos como biológicos.

Indicações

O material auxiliar da OSD foi especialmente desenvolvido para facilitar a colocação ou a explantação dos implantes SAXXO e só pode ser utilizado para esta utilização.

É da responsabilidade do estabelecimento de saúde proceder à pré-desinfecção, à limpeza e à esterilização do equipamento auxiliar depois da sua utilização segundo os métodos validados. As recomendações aqui referidas não substituem as regras sanitárias em vigor: normas, boas práticas, guias, recomendações nacionais, textos ministeriais, etc.

Contraindicações

Alergia conhecida a um dos componentes do material auxiliar (nomeadamente ao níquel).

As contra-indicações estão principalmente associadas ao dispositivo SAXXO (manual dos IMPLANTES SAXXO: Rev_20170615_SAX_IFU).

A OSD renuncia a qualquer responsabilidade no caso de incumprimento das indicações e contra-indicações do equipamento auxiliar e dos implantes SAXXO.

Inspecção e verificação da funcionalidade dos equipamentos auxiliares SAXXO

Por medida de prevenção contra eventuais lesões nos doentes e utilizadores, deve ser sempre executado um controlo aquando da receção do instrumento e antes de cada utilização. Qualquer deterioração pode resultar em riscos de mau funcionamento.

Aquando da receção, os conjuntos de dispositivos devem ser objeto de um exame minucioso.

A referência do material auxiliar está inscrita no dispositivo.

Além disto, é importante verificar a disponibilidade do conjunto dos dispositivos, como os tamanhos diferentes (exemplo: cânulas) que constituem o conjunto de equipamento auxiliar, segundo as instruções e necessidades formuladas pelo cirurgião.

É anexada uma lista do material entregue aquando do envio do equipamento auxiliar.

Se um instrumento estiver associado a outro durante o procedimento cirúrgico, é necessário verificar se os dispositivos combinam corretamente. Verificar a ação das peças móveis (exemplo, alicate) para certificar-se do seu correto funcionamento. As precisões e as modalidades de utilização estão disponíveis no sítio de Internet da OSD: <http://www.osdevelopment.fr>

Inspecione com atenção cada dispositivo para certificar-se de que qualquer contaminação visível foi bem eliminada ou que qualquer dano/ou desgaste excessivo são identificados.

Em caso de contaminação visível, é obrigatório renovar o procedimento de limpeza e de desinfecção.

Todos os dispositivos danificados devem ser isolados e devolvidos à OSD.

Reações adversas

Alergia a um dos componentes do material auxiliar.

Reações adversas dos implantes SAXXO (manual dos IMPLANTES SAXXO: Rev_20170615_SAX_IFU)

• Advertências e precauções

Devem ser tomadas medidas de precaução durante a manipulação dos dispositivos, nomeadamente no caso de dispositivos pontiagudos ou afiados.

No caso de um instrumento ser entregue sozinho. Aquando da receção é necessário retirar a saqueta de plástico antes da limpeza e da esterilização.

Os instrumentos articulados (alicates) devem ser abertos, para melhorar a eficácia da lavagem.

A fim de garantir a funcionalidade e a segurança do material, as instruções aqui referidas devem ser cumpridas:

- A abertura da embalagem deve ser realizada na proximidade do campo operatório;
- Os DM devem ser manipulados com precaução;
- É proibida a utilização de escovas, esfregões de metal ou qualquer outra ferramenta suscetível de alterar o material auxiliar durante os procedimentos de limpeza manual.
- Privilegiar a utilização de escovas de nylon com cerdas suaves.
- É proibida a utilização de produtos químicos à base de cloro, ácidos, solventes orgânicos ou amoniacais.
- A utilização de produtos químicos à base de soda é proibida para os contentores.
- É proibida a utilização de ácido para a neutralização de resíduos alcalinos no fim do ciclo de lavagem automática nos tabuleiros em alumínio e nos instrumentos com elementos em polímero.
- De uma forma geral, é necessário prestar atenção aos vários elementos no caso de vir a faltar uma peça: quer tenha sido perdida ou partida, deverá contactar a OSD.
- Não deixar secar os instrumentos depois da utilização. Os dispositivos sujos que secam são depois mais difíceis de limpar.
- Não utilizar óleo mineral ou lubrificantes à base de silicone porque revestem os micro-organismos impedindo o contacto direto da superfície com o vapor e sendo também difíceis de eliminar.
- Não fazer modificações nos instrumentos.
- O soro fisiológico e os agentes de limpeza/desinfecção com aldeído, mercúrio, cloro ativo, cloreto, bromo, brometo, iodo ou iodeto são corrosivos e não devem ser utilizados.
- São recomendados agentes de limpeza e enzimáticos com pH neutro.

Observação: Os atos de ortopedia não são considerados como de risco em relação aos ATNC. Deve ser feita uma inativação total utilizando soda molar (1N) ou hipoclorito de sódio na concentração de 2% de cloro ativo apenas nos instrumentos que foram utilizados num doente onde existe suspeita ou com EET antes do ato invasivo.

• Precaução/reprocessamento

Se necessário, é obrigatório retirar os excessos de líquidos orgânicos e de tecidos dos instrumentos com um toalhete sem pelos descartável.

Recomenda-se não deixar secar a solução salina, o sangue, os fragmentos ósseos, tecidulares ou outros resíduos orgânicos nos instrumentos antes de os limpar.

Colocar os instrumentos num recipiente de água destilada ou num tabuleiro coberto com toalhetes húmidos.

Deve ser usada equipamento de proteção pessoal durante a manipulação dos dispositivos contaminados.

• Pré-desinfecção

A pré-desinfecção tem por objetivo diminuir a população de micro-organismos e facilitar a limpeza posterior. Pretende também proteger o pessoal durante a manipulação dos instrumentos e evitar a contaminação do ambiente. Todos os dispositivos reutilizáveis devem ser sujeitos a uma pré-desinfecção imediata ou tratados rapidamente em lavador-aparelho de desinfecção.

ATENÇÃO: Os contentores e tabuleiros de arrumação não devem estar em contacto prolongado com este tipo de descontaminante; limpar a zona suja e enxaguar imediatamente.

- **ATNC**

É necessário respeitar as disposições em:

- Instrução francesa DGS/RI3/2001/449 de 1 de dezembro de 2011 relativa à atualização das recomendações que visa reduzir os riscos de transmissões de agentes transmissíveis não convencionais durante atos invasivos
- Circular francesa DGS/SD5C/DHOS/2005/435 de 23 de setembro de 2005 relativa às recomendações para o tratamento dos dispositivos médicos utilizados nos doentes que tenham recebido hemocomponentes provenientes de doadores que sofrem retrospectivamente de variante da doença de Creutzfeld-Jakob (vDCJ).

Instruções de limpeza, desinfeção e esterilização:

- **Limpeza/desinfeção:**

A limpeza e a desinfeção segundo o procedimento indicado são obrigatórias antes da esterilização dos materiais auxiliares reutilizáveis.

Esta etapa tem por objetivo retirar toda a sujidade e resíduos nos equipamentos auxiliares depois da intervenção, a fim de reduzir o número de micro-organismos viáveis no equipamento auxiliar antes da esterilização.

Os métodos de limpeza e de desinfeção geralmente utilizados são: a limpeza manual e a limpeza automática.

A escolha do meio utilizado é da responsabilidade do estabelecimento.

A fim de garantir a eficácia da limpeza e da desinfeção, cumprir as instruções do produto de limpeza.

Durante esta etapa, deve ser dada uma atenção particular às zonas sensíveis e/ou de acesso difícil para que o produto e a ação de limpeza sejam ideais.

Numa primeira fase, é indispensável retirar os excessos de líquidos e de tecidos orgânicos com um tampão sem pelos descartável. Depois, colocar os dispositivos num tabuleiro de água destilada ou cobrir com um pano húmido.

Procedimento de limpeza/desinfeção automática:

Colocar os instrumentos no cesto de um lavador/aparelho de desinfeção adaptado, conforme as instruções do fabricante e tratar através do ciclo recomendado para os equipamentos auxiliares da OSD e descrito abaixo:

- **Pré-limpeza**

- Desmontar os instrumentos, se for necessário.
- Imersão durante 5 min., pelo menos, em água fria da torneira.
- Escovar as superfícies com uma escova de nylon até retirar toda a sujidade visível.
- Enxaguar durante 20 segundos com jato de pressão (entre 3 e 4 bares ou 43,5 e 58 psi), insistindo nas cânulas.

- **Lavador/aparelho de desinfeção**

Utilizar um lavador/aparelho de desinfeção de tipo MIELE G7735 CD assim como o seu programa Vario TD, segundo estas etapas:

- 2 minutos de pré-limpeza em água fria
- Drenar.
- 5 minutos de limpeza em água desmineralizada a 55 °C e 0,5% de detergente alcalino suave, (exemplo: NeodisherMediClean - Dr.Weigert).
- Drenar.
- 3 minutos de enxaguamento e de neutralização com água desmineralizada.
- Drenar.
- 2 min de enxaguamento final com água desmineralizada
- Drenar.
- Secagem, pano seco, sem pelos, limpo ou esterilizado.

Verificar que os instrumentos e os orifícios não possuem qualquer sujidade.

Se necessário, repetir o ciclo de limpeza.

Depois da limpeza/desinfeção, os instrumentos desmontados devem ser remontados e inspecionados visualmente.

- **Inspeção antes da esterilização:**

Inspecionar com atenção cada dispositivo para garantir a eliminação de qualquer contaminação visível. Se necessário, repetir o processo de limpeza e de desinfecção.

Verificar também a ausência de deformação dos instrumentos.

- **Esterilização:**

A obtenção e a manutenção do estado esterilizado dos equipamentos auxiliares são da responsabilidade dos estabelecimentos de saúde. A esterilização a vapor/calor húmido é o método recomendado.

Todavia, o serviço comercial da OSD está disponível para fornecer-lhe todas as informações complementares.

As disposições a tomar para a proteção das arestas pontiagudas ou potencialmente cortantes dos instrumentos devem também ser consideradas pelo estabelecimento de saúde.

A OSD recomenda o cumprimento das recomendações do fabricante do esterilizador, que devem ser sempre cumpridas. Durante a esterilização de vários conjuntos de instrumentos num ciclo de esterilização, é importante assegurar que a carga máxima indicada pelo fabricante não é ultrapassada.

Os conjuntos de instrumentos devem ser corretamente preparados e embalados nos tabuleiros e/ou caixas para permitir ao vapor penetrar e entrar em contacto direto com todas as superfícies.

Consultar as informações abaixo com os parâmetros de esterilização dos ciclos validados pela OSD para obter um nível de garantia de esterilidade (NGE) de 10^{-6} .

Os métodos de esterilização com óxido de etileno ou plasma não devem ser utilizados.

Parâmetros de esterilização a vapor validados:

Tipo de ciclo: pré-vácuo - Temperatura 134 °C (273,2 °F)

Duração da exposição: 18 minutos - Tempo de secagem: 20 minutos.

REPARAÇÕES

Todos os dispositivos danificados devem deixar de ser utilizados e devem ser devolvidos para reparação à OSD.

Para proteger as pessoas responsáveis pela reparação, os instrumentos só podem ser reenviados para reparação se forem submetidos a procedimentos de descontaminação/limpeza/esterilização. Se os instrumentos auxiliares estiverem sujos ou se forem observadas modificações nos produtos a reparar, a OSD reserva o direito de reparar os DM com custos para si ou recusar-se completamente a proceder à reparação.

A OSD recusa qualquer responsabilidade em caso de modificação ou de reparação efetuada nos dispositivos pelo estabelecimento.

ELIMINAÇÃO

Se for necessário eliminar o dispositivo, deve fazê-lo seguindo as boas práticas de eliminação de resíduos de atividades de cuidados de saúde com risco infeccioso. Não existe nenhum risco especial ou não usual relacionado com a eliminação deste dispositivo.

DEVOLUÇÃO DA REMESSA

O estabelecimento de saúde deve desinfetar, limpar, esterilizar e embalar devidamente os equipamentos auxiliares emprestados (caixa completa ou instrumento isolado) antes de os devolver à OSD.

Além disto, quando o estabelecimento de saúde não é proprietário do DM, deverá aceitar a faturação e tomar todas as medidas necessárias para proceder ao seu pagamento nos seguintes casos:

- Quando o DM se destina a ser utilizado em circunstâncias onde se suspeita de contacto com ATNC (doente ou ato cirúrgico de risco);

- Quando é imposta uma destruição do DM no âmbito da observação de regras sanitárias, assim como no caso de incumprimento das instruções da OSD mencionadas no presente manual em matéria de armazenamento, descontaminação, limpeza e esterilização que resultem na deterioração do material.

GARANTIA

A empresa OSD garante que os seus produtos são fornecidos em conformidade com as especificações que lhes são associadas.








Por outro lado, esta garantia não se aplica em caso de má utilização ou de má manipulação do dispositivo. A OSD recusa qualquer responsabilidade quanto à utilização de acessórios adicionais durante a implantação do dispositivo SAXXO.

Todos os instrumentos com defeito devem ser devolvidos à OSD para serem substituídos ou destruídos.

Este manual deve estar acessível e guardado na proximidade dos instrumentos. A OSD não pode ser responsabilizada por danos resultantes de uma má utilização e/ou manipulação do dispositivos e nos casos em que sejam feitas reparações e/ou modificações nos instrumentos por uma pessoa não autorizada.

A empresa OSD não garante o resultado clínico, reconhecendo que riscos residuais podem comprometer o êxito da cirurgia.

Para garantir uma utilização ideal dos dispositivos, deverá respeitar os seguintes símbolos:

Símbolos utilizados						
						
Consulte o manual de instruções	Fabricante	Não esterilizado	Não utilizar se a embalagem estiver danificada	Número de catálogo	Guardar afastado da luz solar	Proteger da humidade

**ORTHOPAEDIC & SPINE
DEVELOPMENT**
Chemin de Fontanille - BP 11211

84911 AVIGNON Cedex 9 - FRANCE


Tél : +33 (0)4.32.74.01.10

Fax : +33 (0)4.90.80.02.39

info@osdevelopment.fr

www.osdevelopment.fr

Material auxiliar SAXXO

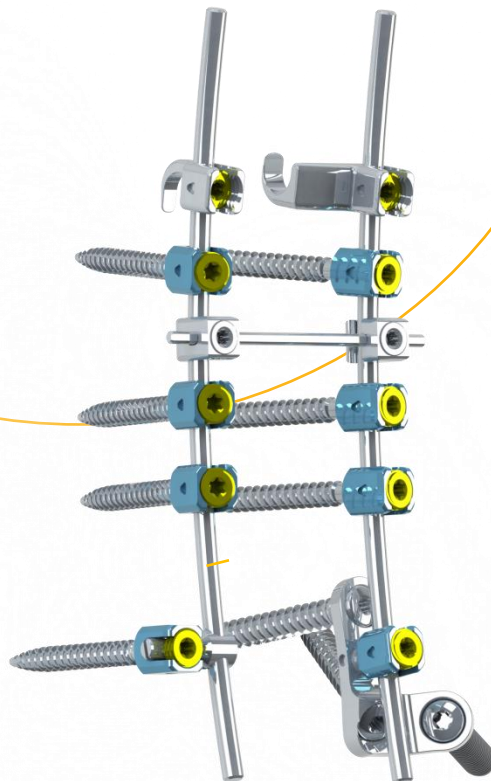

Generalități

OSD recomandă ca întreg personalul îngrijitor care are contact cu materialul auxiliar să ia la cunoștință prezentele instrucțiuni de utilizare.

Utilizarea materialului auxiliar necesită cunoștințe de anatomie, biomecanică și chirurgie a coloanei vertebrale; materialul auxiliar nu poate fi utilizat decât de un chirurg calificat care practică acest tip de intervenție chirurgicală luând în calcul datele disponibile în prezent oferite de știință și arta chirurgicală.

Descriere

Echipamentul auxiliar este alcătuit din instrumente (material auxiliar), soluții de depozitare și un recipient.

Este necesar să vă familiarizați cu tehnica operatorie, iar în caz de nelămuriri contactați reprezentantul societății OSD pentru a obține toate informațiile necesare privind utilizarea materialului auxiliar și a implanturilor asociate.

În plus, anumite instrumente nu sunt furnizate împreună cu setul standard și pot fi puse la dispoziție la cerere.

Nu trebuie implantat niciun material auxiliar sau componentă a materialului auxiliar.

Materialul auxiliar poate fi fabricat din oțel inoxidabil, aliaj de titan, polimer și silicon.

Materialele sunt biocompatibile, în plus orice modificare adusă dispozitivelor le poate afecta performanțele tehnice și biologice.

Indicații

Materialul auxiliar OSD a fost conceput special pentru a facilita aplicarea sau explantarea implanturilor SAXXO și nu poate fi utilizat decât în acest fel.

Instituția sanitară are obligația să efectueze dezinfectarea preliminară, curățarea și sterilizarea materialului auxiliar după utilizare conform metodelor validate. Recomandările anexate nu înlocuiesc regulile sanitare în vigoare: norme, bune practici, ghiduri, recomandări naționale, texte ministeriale, etc.

Contraindicații

Alergie cunoscută la una dintre componentele materialului auxiliar (în special la nichel).

Contraindicațiile sunt asociate în principal cu dispozitivul SAXXO (manualul IMPLANTURI SAXXO: Rev_20170615_SAX_IFU).

OSD își declină orice răspundere în cazul nerespectării indicațiilor și a contraindicațiilor privind materialul auxiliar și implanturile SAXXO.

Inspekția și verificarea funcționării materialului auxiliar SAXXO

Pentru a preveni leziunile eventuale ale pacienților și utilizatorilor, trebuie efectuat întotdeauna un control la primirea instrumentului și înainte de fiecare utilizare. Orice deteriorare poate determina riscuri de funcționare defectuoasă.

În momentul recepției, seturile de instrumente trebuie să facă obiectul unei examinări minuțioase.

Referința privind materialul auxiliar este înscrisă pe dispozitiv.

De asemenea, este important să verificați disponibilitatea tuturor dispozitivelor, dacă este cazul a diferitelor dimensiuni (de exemplu robinetele) care constituie setul materialului auxiliar, pornind de la instrucțiunile și nevoile formulate de chirurg.

La transportul materialului auxiliar este anexată o listă cu materialul livrat.

Atunci când un instrument este îmbinat cu altul în timpul procedurii chirurgicale, este necesar să verificați dacă dispozitivele se asamblează corect. Verificați acțiunea pieselor mobile (de exemplu, clește) pentru a vă asigura de buna funcționare a acestora, precizia și modurile de utilizare sunt disponibile pe site-ul de internet OSD: <http://www.osdevelopment.fr>

Verificați atent fiecare dispozitiv pentru a vă asigura că orice contaminare vizibilă a fost eliminată sau că a fost identificată orice deteriorare și/sau uzură excesivă.

În caz de contaminare vizibilă, este imperativ să reînnoiți procedura de curățare și dezinfectare.

Orice dispozitiv deteriorat trebuie izolat și returnat către OSD.

Reacții adverse

Alergie la una dintre componentele materialului auxiliar.

Reacții adverse ale implanturilor SAXXO (manualul IMPLANTURI SAXXO: Rev_20170615_SAX_IFU)

- **Avertismente și precauții**

Trebuie luate măsuri de precauție pentru manipularea dispozitivelor, în special în cazul dispozitivelor ascuțite sau tăioase. În cazul unui instrument livrat singur. În momentul recepției, este necesar să îndepărtați ambalajul din plastic înainte de curățare și sterilizare.

Instrumentele articulate (clește) trebuie deschise, pentru a îmbunătăți eficiența spălării.

Pentru a garanta funcționarea și siguranța materialului, trebuie respectate recomandările de mai jos:

- Deschiderea ambalajului trebuie realizată în apropierea câmpului operator;
- Dispozitivele medicale trebuie manipulate cu atenție;
- Trebuie evitată utilizarea periiilor, a bureților de sârmă metalici sau a oricărui alt instrument susceptibil să modifice materialul auxiliar în timpul procedurilor de curățare manuale.
- Utilizați cu precădere perii din nylon cu peri moi.
- Trebuie evitată utilizarea produselor chimice pe bază de clor, acizi, solvenți organici sau amoniacali.
- Trebuie evitată utilizarea produselor chimice pe bază de sodiu pentru recipiente.
- Trebuie evitată utilizarea acidului pentru neutralizarea reziduurilor alcaline la sfârșitul ciclului de spălare automat pe tăvile din aluminiu și instrumentele cu elemente polimerice.
- În general, trebuie să fiți atenți la diferitele elemente în cazul în care o piesă lipsește: pierdută sau deteriorată; în acest caz vă invităm să contactați OSD.
- Nu lăsați instrumentele să se usuce după utilizare, dispozitivele murdare care s-au uscat sunt mai dificil de curățat.
- Nu utilizați ulei mineral sau lubrifiați pe bază de silicon deoarece acoperă microorganismele, împiedică contactul direct al suprafeței cu vaporii și sunt dificil de eliminat.
- Nu modificați instrumentele.
- Serul fiziologic și agenții de curățare/dezinfecare care conțin aldehydă, mercur, clor activ, clorură, brom, bromură, iod sau iodură sunt corozivi și nu trebuie utilizați.
- Sunt recomandați agenții de curățare și enzimatici cu pH neutru.

Observație: Intervențiile ortopedice nu sunt considerate ca prezentând risc privind agenții transmisibili neconvenționali. Inactivarea totală cu ajutorul hidroxidului de sodiu (1N) sau a hipocloritului de sodiu cu concentrație de 2% de clor activ trebuie rezervată doar instrumentelor folosite la un pacient suspect sau afectat de encefalită spongiformă transmisibilă înainte de intervenția invazivă.

- **Precauție/retratere**

Dacă este cazul, este imperativ să eliminați lichidele organice și țesuturile în exces din instrumente folosind un tampon fără scame de unică folosință.

Se recomandă să nu lăsați să se usuce soluția salină, sângele, fragmentele osoase, de țesut sau alte reziduuri organice de pe instrumente înainte de a le curăța.

Introduceți instrumentele într-un recipient cu apă distilată sau într-o tavă acoperită cu șervețele umede.

Trebuie să folosiți un echipament individual de protecție în timpul manipulării dispozitivelor contaminate.

- **Dezinfecarea preliminară**

Dezinfecarea preliminară are drept obiectiv diminuarea populației de microorganisme și facilitarea curățării ulterioare. De asemenea, are drept obiectiv protejerea personalului în timpul manipulării instrumentelor și evitarea contaminării mediului. Orice dispozitiv reutilizabil trebuie să fie supus unei dezinfecări preliminare imediate sau tratat imediat în mașina de spălat și dezinfecat.

ATENȚIE: Recipientele și tăvile de depozitare nu trebuie lăsate în contact prelungit cu acest tip de substanță decontaminantă; curățați zona murdară și clătiți imediat.

- **ATNC**

Trebuie să respectați dispozițiile din:

- Directiva franceză DGS/RI3/2001/449 din 1 decembrie 2011 privind actualizarea recomandărilor de reducere a riscurilor de transmitere a agenților transmisibili neconvenționali în timpul intervențiilor invazive
- Circulara franceză DGS/SD5C/DHOS/2005/435 din 23 septembrie 2005 privind recomandările pentru tratarea dispozitivelor medicale utilizate la subiecții care au primit produse sanguine labile (PSL) provenite de la donatorii afectați retrospectiv de o variantă a bolii Creutzfeld-Jakob (vMCJ).

Instrucțiuni de curățare, dezinfectare și sterilizare:

- **Curățare/dezinfectare:**

Curățarea și dezinfectarea conform procedurii indicate sunt obligatorii înainte de sterilizarea materialelor auxiliare reutilizabile.

Această etapă are rolul de a îndepărta toată mizeria și reziduurile de pe materialele auxiliare ca urmare a intervenției pentru a reduce numărul de microorganisme viabile de pe materialele auxiliare înainte de sterilizare.

Metodele de curățare și dezinfectare utilizate în prezent sunt: curățarea manuală și curățarea automată.

Alegerea mijlocului de utilizat revine în sarcina instituției.

Pentru a garanta eficacitatea curățării și a dezinfectării, respectați manualul produsului de curățare.

În această etapă, trebuie acordată o atenție deosebită zonelor sensibile și/sau cu acces dificil pentru ca produsul și acțiunea de curățare să fie optime.

Mai întâi, trebuie să eliminați excesul de lichide și țesuturi organice folosind un tampon fără scame de unică folosință. Apoi așezați dispozitivele într-o tavă cu apă distilată sau acoperiți-le cu o pânză umedă.

Procedura de curățare/dezinfectare automată:

Așezați instrumentele în coșul unei mașini de spălat/dezinfectat adecvat respectând instrucțiunile producătorului și procedați conform ciclului recomandat pentru materialele auxiliare OSD și descris mai jos:

- **Curățarea preliminară**

- Dezasamblați instrumentele, dacă este cazul.
- Introduceți timp de cel puțin 5 minute în apă rece de la robinet.
- Frecați cu o perie din nylon suprafețele până la dispariția mizeriei vizibile.
- Clătiți timp de 20 de secunde sub jet cu presiune (între 3 și 4 bari sau 43,5 și 58 psi), insistând asupra canalelor.

- **Mașină de spălat/dezinfectat**

Folosiți o mașină de spălat/dezinfectat de tip MIELE G7735 CD, precum și programul Vario TD, conform următorilor pași:

- 2 minute de curățare preliminară în apă rece
- Purjați.
- 5 minute de curățare în apă demineralizată la 55°C și 0,5% detergent alcalin ușor, (exemplu: NeodisherMediClean - Dr.Weigert).
- Purjați.
- 3 minute de clătire și neutralizare cu apă demineralizată.
- Purjați.
- 2 minute de clătire finală cu apă demineralizată
- Drenați.
- Uscare cu o cârpă uscată, fără scame, curată și sterilă.

Verificați dacă instrumentele și ledurile nu prezintă mizerie.

Dacă este nevoie, repetați ciclul de spălare.

După curățare/dezinfectare, instrumentele dezasamblate trebuie asamblate și inspectate vizual.

- **Inspecție înainte de sterilizare:**

Verificați atent fiecare dispozitiv pentru a asigura eliminarea oricărei contaminări vizibile. Dacă este nevoie, repetați procesul de curățare și dezinfectare.

De altfel, verificați absența deformării instrumentelor.

- **Sterilizare:**

Obținerea și menținerea stării de sterilitate a materialelor auxiliare revin în sarcina instituției sanitare. Sterilizarea la aburi/căldură umedă este metoda recomandată.

Totuși, serviciul clienți OSD vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare.

Instituția sanitară trebuie să aibă în vedere măsurile pentru protecția muchiilor ascuțite sau care pot răni ale instrumentelor.



OSD recomandă întotdeauna respectarea recomandărilor producătorului sterilizatorului. În timpul sterilizării mai multor seturi de instrumente într-un ciclu de sterilizare, trebuie să vă asigurați că nu depășiți sarcina maximă indicată de producător. Seturile de instrumente trebuie pregătite corect și ambalate în tăvi și/sau cutii pentru a permite vaporilor să penetreze și să intre în contact direct cu toate suprafețele.

Consultați informațiile de mai jos pentru parametrii de sterilizare a ciclurilor validați de OSD pentru a oferi un nivel de asigurare a sterilității (NAS) de 10^{-6} .

Metodele de sterilizare cu oxid de etilenă sau plasmă nu trebuie utilizate.

Parametrii de sterilizare cu aburi validați:

Tipul de ciclu: vid prealabil - Temperatură 134° C (273,2°F)

Durata expunerii: 18 minute - Timp de uscare: 20 minute.

REPARAȚII

Orice dispozitiv deteriorat nu trebuie utilizat, ci returnat pentru reparații la OSD.

Pentru a proteja persoanele care se ocupă de reparație, instrumentele nu pot fi trimise spre reparație decât după ce au fost supuse procedurilor de decontaminare/curățare/sterilizare. Dacă materialele auxiliare sunt murdare sau dacă sunt constatate modificări la produsele de reparat, OSD își rezervă dreptul de a repara dispozitivele medicale pe cheltuiala dvs. sau de a refuza complet reparația.

OSD își declină orice răspundere în caz de modificare sau reparație efectuată la dispozitivele pentru instituție.

ELIMINAREA

Dacă este cazul, dispozitivul poate fi eliminat conform bunelor practici de eliminare a deșeurilor rezultate din activitatea de îngrijire cu risc infecțios. Nu există un risc special sau neobișnuit legat de eliminarea acestui dispozitiv.

RETURNAREA MATERIALULUI

Instituția sanitară trebuie să dezinfecteze, curățe, sterilizeze și ambaleze materialul auxiliar adecvat (cutie completă sau instrument izolat) înainte de a-l returna OSD.

Dacă instituția sanitară nu deține proprietatea asupra dispozitivului medical, aceasta acceptă facturarea și ia toate măsurile necesare legate de plată în următoarele cazuri:

- Dacă dispozitivul medical este utilizat în situații în care există suspiciunea contactului cu agenții transmisibili neconvenționali (pacient sau intervenție chirurgicală cu risc);
- Când distrugerea dispozitivului medical este impusă în cadrul respectării normelor sanitare, precum și în cazul nerespectării recomandărilor OSD menționate în prezentul manual în materie de depozitare, decontaminare, curățare și sterilizare și determină o deteriorare a materialului.

GARANȚIE

Societatea OSD garantează că produsele livrate sunt conforme cu specificațiile asociate.








În plus, garanția nu se aplică în caz de utilizare greșită sau de manipulare necorespunzătoare a dispozitivului. OSD își declină orice răspundere referitor la utilizarea accesoriilor suplimentare folosite în timpul implantării dispozitivului SAXXO.

Orice instrument defect trebuie returnat către OSD pentru a fi înlocuit, chiar distrus.

Manualul trebuie să fie accesibil și păstrat în apropierea instrumentului, societatea OSD nu va fi considerată responsabilă pentru daunele rezultate din utilizarea și/sau manipularea incorecte a dispozitivului și în cazul în care reparațiile și/sau modificările sunt aduse instrumentului de o persoană neautorizată.

Societatea OSD nu garantează rezultatul clinic, știind că riscurile reziduale pot compromite reușita intervenției chirurgicale.

Pentru a asigura utilizarea optimă a dispozitivelor, trebuie respectate simbolurile următoare:

Simboluri utilizate						
 A se consulta manualul de utilizare	 Fabricant	 Nesteril	 A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat	 Nr. catalog	 A se păstra la adăpost de lumina soarelui	 A se păstra la adăpost de umiditate

**ORTHOPAEDIC & SPINE
 DEVELOPMENT**
 Chemin de Fontanille - BP 11211

84911 AVIGNON Cedex 9 - FRANCE

Tél : +33 (0)4.32.74.01.10

Fax : +33 (0)4.90.80.02.39

info@osdevelopment.fr

www.osdevelopment.fr